ASM 200

사용자 매뉴얼



aram HUVIS

내용

구성요소 3

H/W 부분

각 부분의 명칭 4
전원 온/오프 5
배터리 및 동작 중 상태 표시 6

시스템 설정

날짜 및 시간 7
Wi-Fi 9

어플리케이션

설정 10
고객관리 11
렌즈의 탈착/장착 두피진단 (ASM-202 렌즈) 12
탈모 유형 13
두피 상태 14
모발 밀도 15
각질량 16
혈관 노출 17
렌즈의 탈착/장착 모발진단 (ASM-203 렌즈) 18
모발 두께 19
모공 상태 20
렌즈의 탈착/장착 모발진단 (ASM-204 렌즈) 21
모발 상태 22
종합 결과 23
이메일 24
미러링 25
화면 보기 27

보증서 28

※주의사항
- 매뉴얼의 사진은 실제 사진과 다를 수 있습니다.
- 본 매뉴얼에 포함된 정보와 향후 개선사항은 통보 없이 수정될 수 있습니다.
- 매뉴얼의 최신 버젼은 하기 링크에 업데이트 될 것입니다.
  http://www.aramhuvis.com/downloads

구성요소

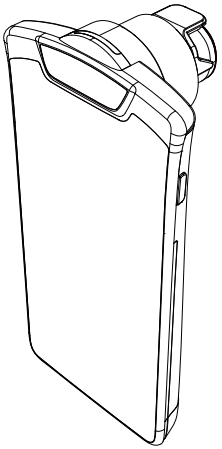

본체

총 3 렌즈



두피 진단용 렌즈
(ASM 202)



모발 진단용 렌즈
(ASM 203)



모발 진단용 렌즈
(ASM 204)

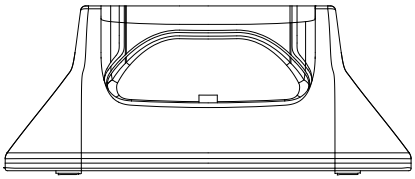

충전 겸용 거치대



클리닝 패브릭



충전기



매뉴얼



USB 케이블



에어블로워

각 부분의 명칭

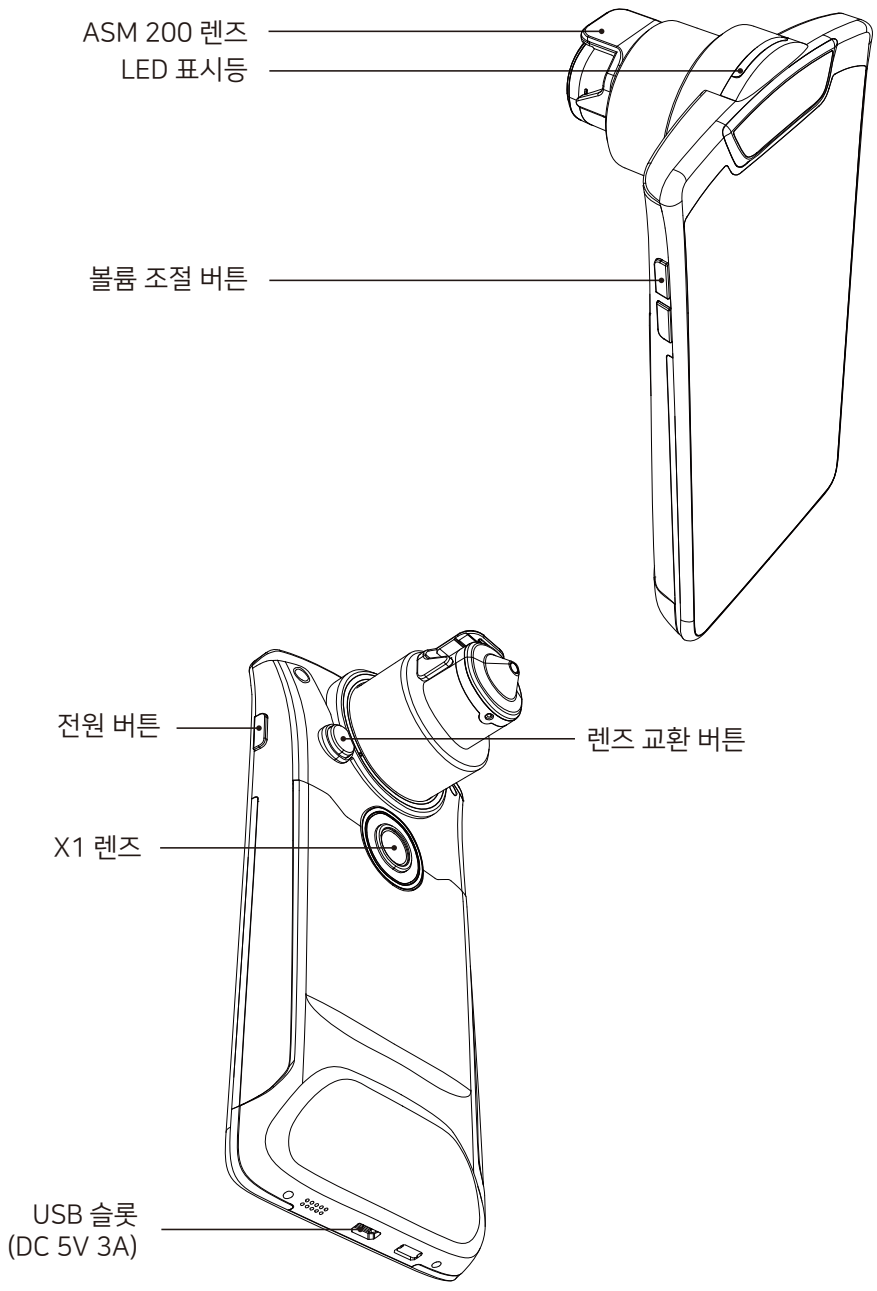

전원 온/오프

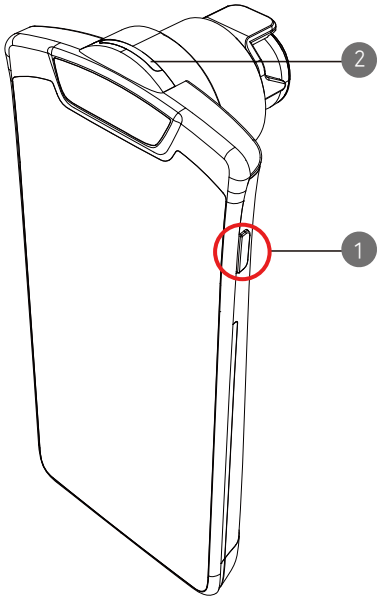

기기 전원 켤 때

❶ 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
❷ 상단의 LED가 켜지면
전원버튼에서 손을 떼세요.

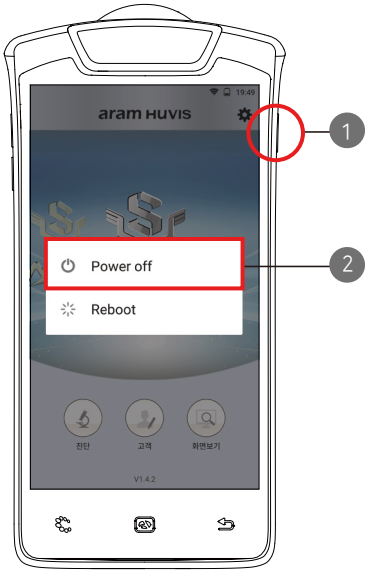

기기 전원 끌 때

❶ 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
❷ 종료를 터치해주세요.

배터리 및 동작 중 상태 표시

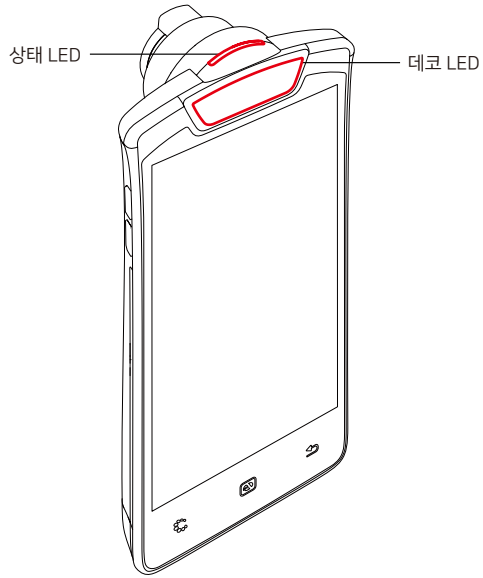

진단기 위치	상태	데코 LED	상태 LED	
사용 중	부팅시	점등	청색 점등	●
사용 중	앱 구동시	점등	꺼짐	●
사용 중	Low 배터리	LCD 화면 상단 인디케이터에서만 표시		
거치대 연결 시	충전 중	꺼짐	적색 점등 (LCD 화면이 꺼졌을 때)	●
거치대 연결 시	충전 완료 (180분)	꺼짐	청색 점등 (LCD 화면이 꺼졌을 때)	●

날짜 및 시간



❶ 버튼을 눌러 홈화면으로 이동합니다.



❷ 버튼을 터치하세요.

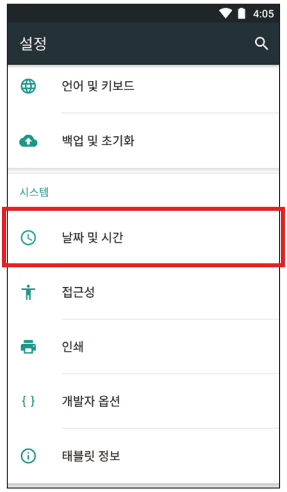

❸ '날짜 및 시간' 메뉴를 터치하세요.

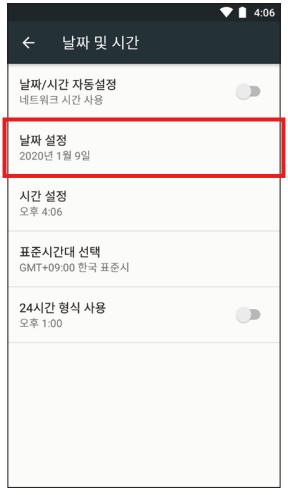

❹ '날짜 설정'을 터치하세요.

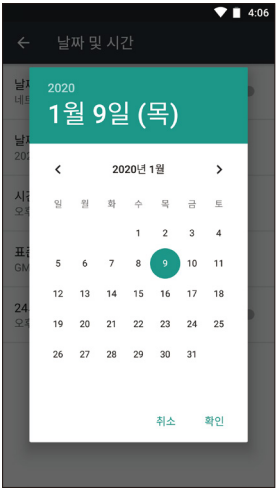

❺ 날짜를 선택하고 확인 버튼을 터치하세요.

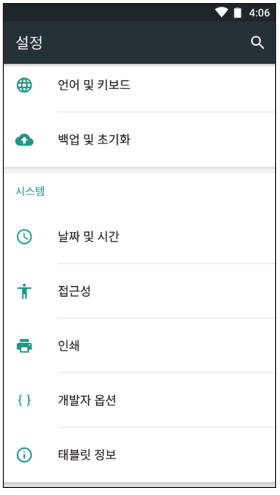

❻ 설정이 올바르게 적용되었는지 확인하세요.

날짜 및 시간

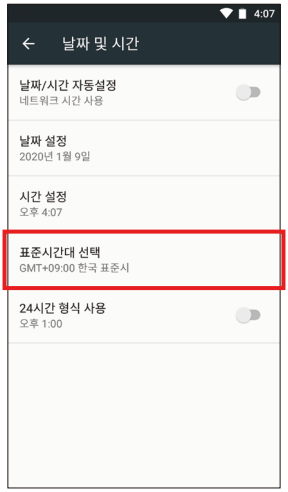

⑦ '표준시간대 선택'을 터치하세요.



⑧ 해당 국가의 표준시간대를 선택하세요.



⑨ 설정이 올바르게 적용되었는지 확인하세요.



⑩ '시간설정'을 터치하세요.

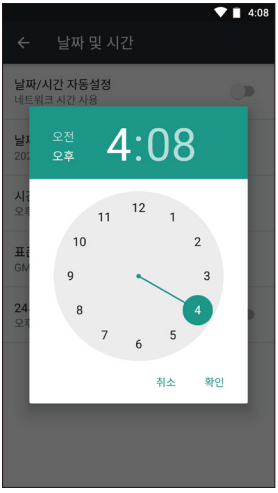

⑪ 현재시간으로 변경하고 확인 버튼을 누릅니다.



⑫ 설정이 올바르게 적용되었는지 확인하세요.

Wi-Fi

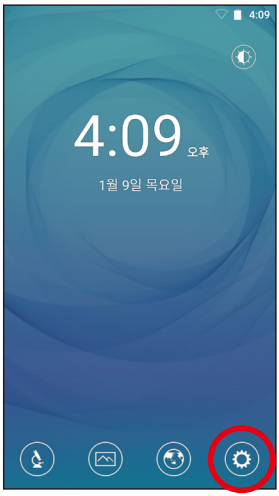

❶ ⚙ 버튼을 터치하세요.

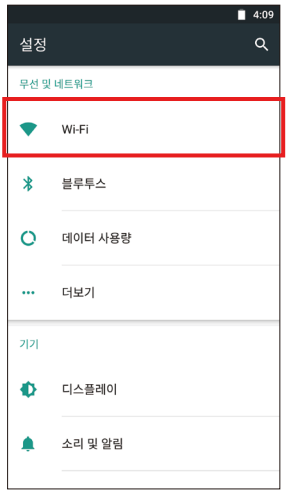

❷ 'Wi-Fi' 메뉴를 터치하세요.

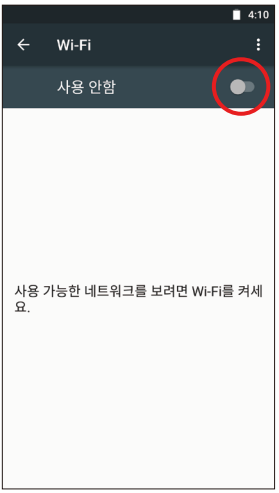

❸ 켜기/끄기 버튼을 사용하여 Wi-Fi를 켜세요.

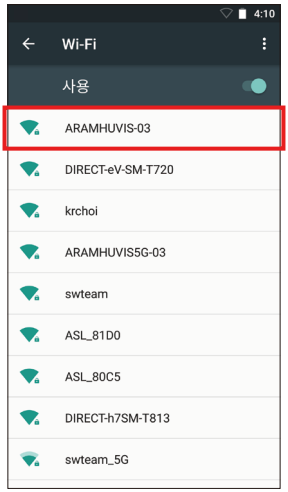

❹ 연결할 Wi-Fi를 선택하세요.

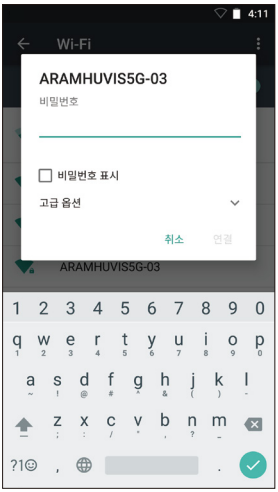

❺ Wi-Fi 비밀번호를 입력하세요.

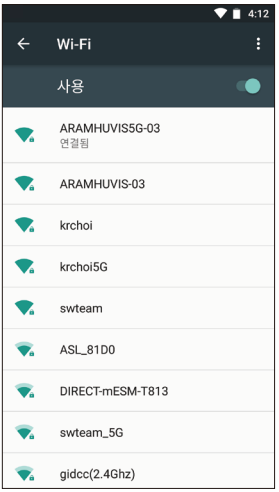

❻ Wi-Fi 연결이 될 때까지 기다리세요.

설정



❶ ⚙ 버튼을 터치하세요.

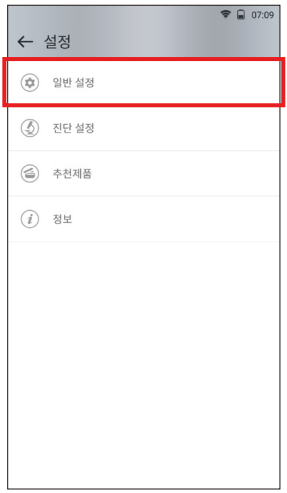

❷ '일반설정'메뉴를 터치하세요.

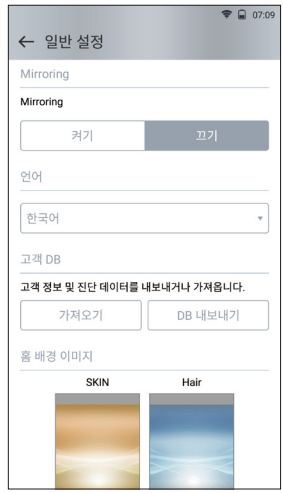

❸ 미러링 및 언어 설정, 고객 DB 관리를 설정 할 수 있습니다.

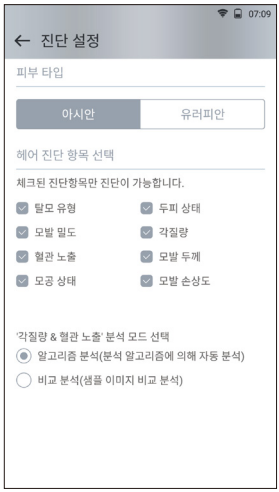

❹ 진단설정에서는 피부타입과 진단 항목을 선택합니다.



❺ 추천제품에서는 진단 결과에 해당하는 추천제품을 등록합니다.



❻ 정보에서 최신 업데이트를 확인하십시오.

고객관리



❶ '고객' 메뉴를 터치하세요.

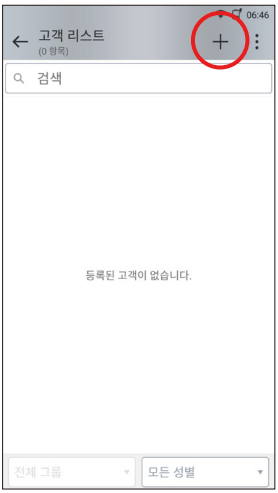

❷ 새 고객을 등록하려면 오른쪽 상단의 '+' 메뉴를 터치하세요

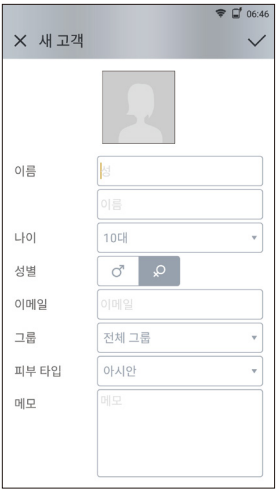

❸ 고객정보를 입력하세요.

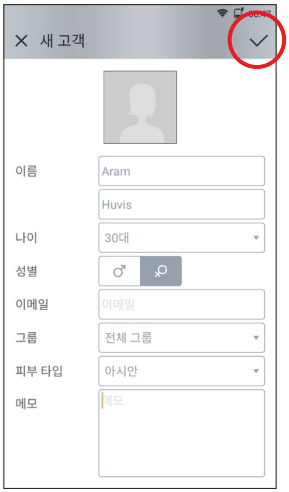

❹ 고객정보를 입력한 후 오른쪽 상단의 ✓ 버튼을 터치하세요.

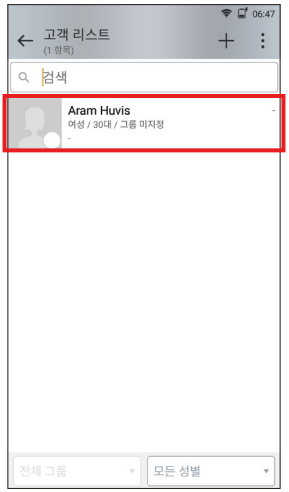

❺ 생성된 사용자 프로필을 선택합니다.

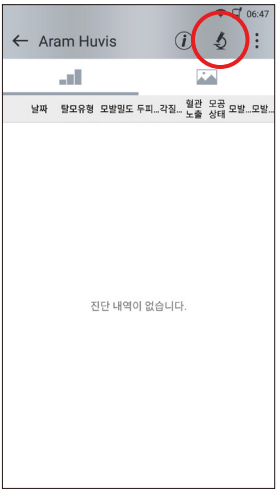

❻ 진단을 시작하려면 버튼을 터치하세요.

렌즈의 탈착 ASM-202

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

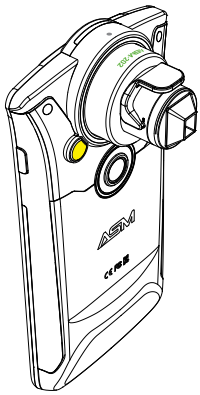

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

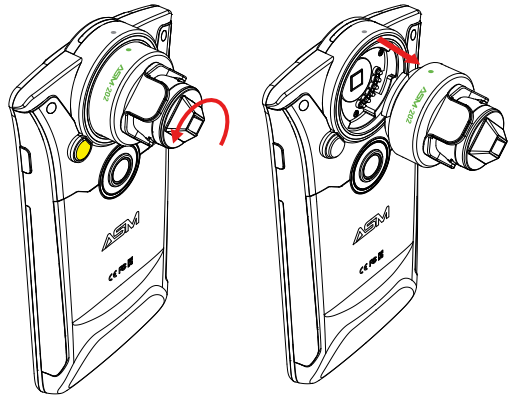

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

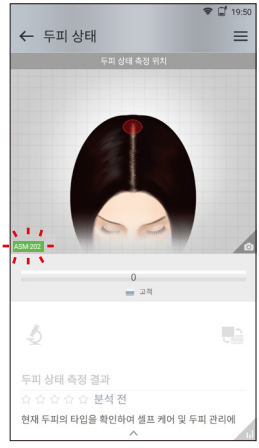

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

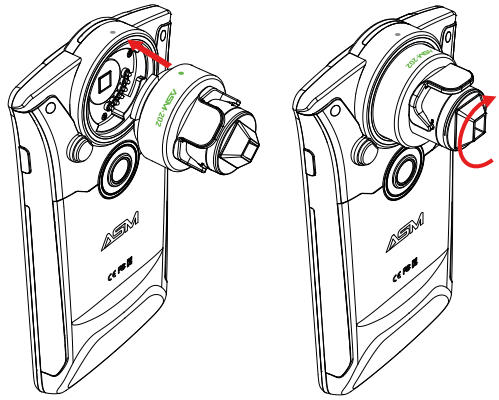

탈모 유형 X1 Lens

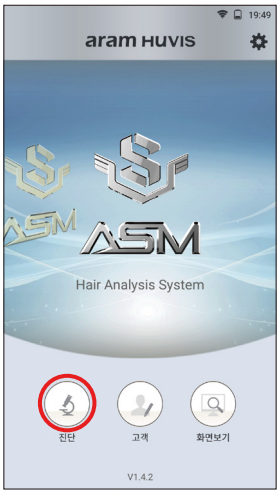

❶ '진단'메뉴를 터치하세요.

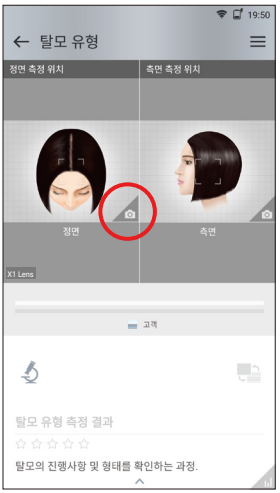

❷ 촬영 위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영 모드로 진입합니다.

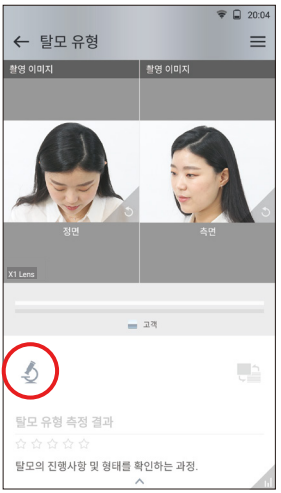

❸ 정면과 측면을 촬영하고 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

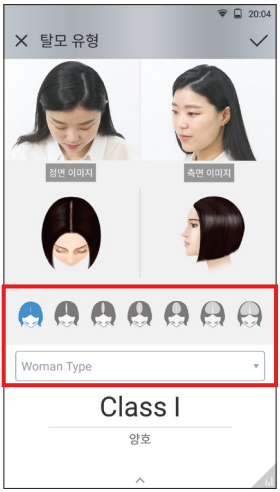

❹ 촬영된 사진에 해당하는 타입과 탈모 진행도를 선택합니다.

*여성의 경우 'Woman Type'만 선택 가능합니다.

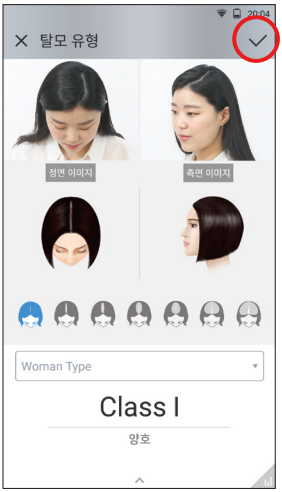

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

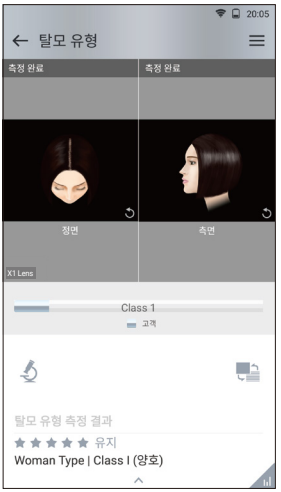

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

두피 상태 ASM-202

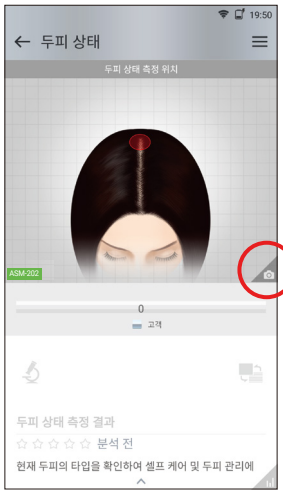

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

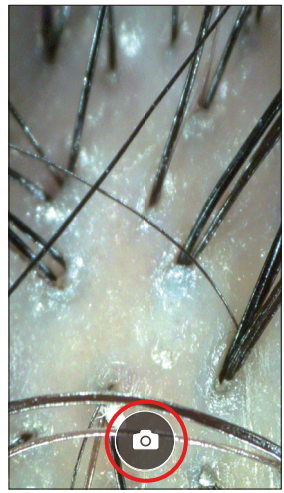

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

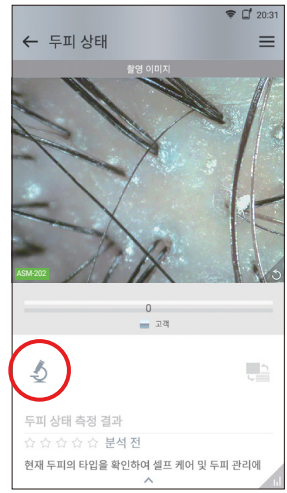

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.



❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

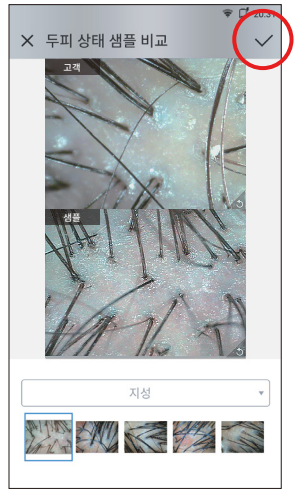

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

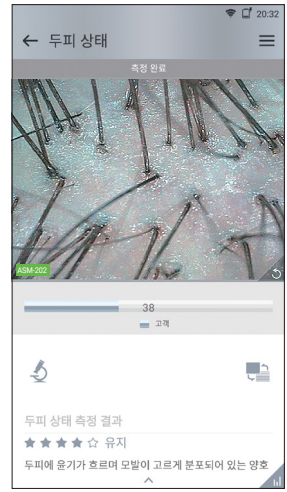

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

모발 밀도 ASM-202

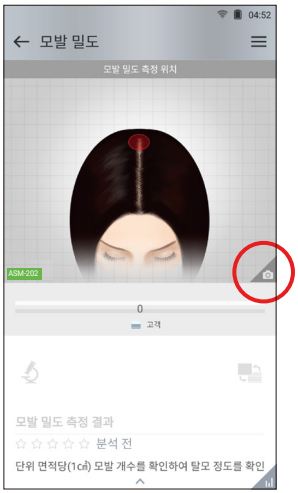

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

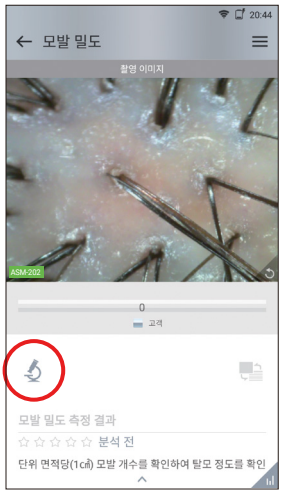

❷ 촬영후 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

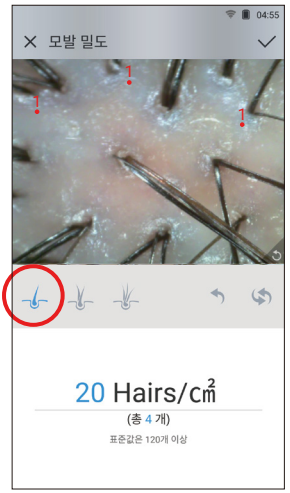

❸ 을 선택하고 사진에서 모발이 1개인 모공을 터치합니다.

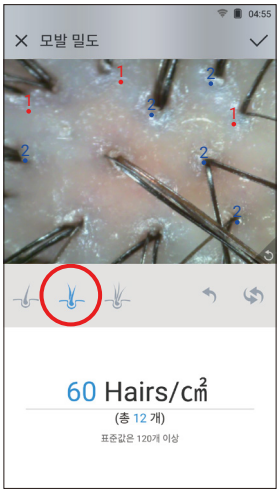

❹ 마찬가지로 모발이 2개, 3개인 모공을 각각 터치하여 합산합니다.

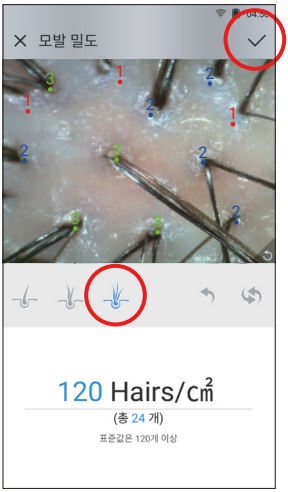

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

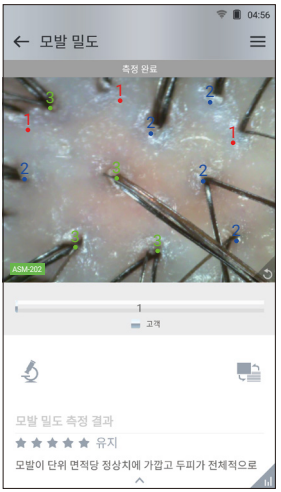

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

각질량 ASM-202

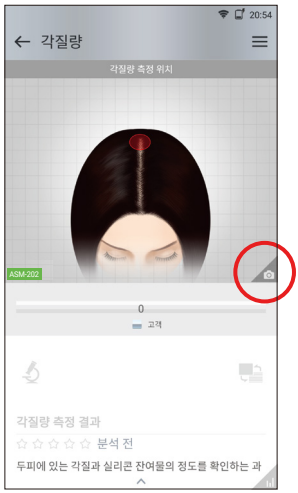

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.



❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

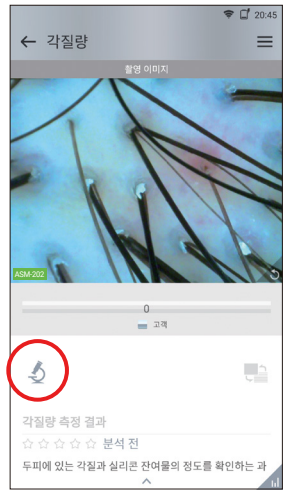

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

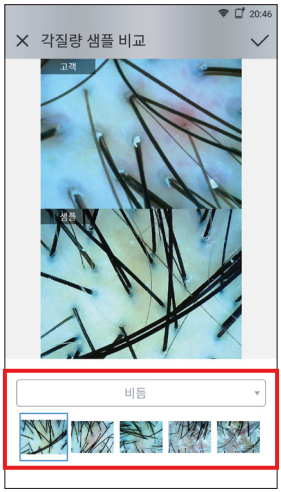

❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

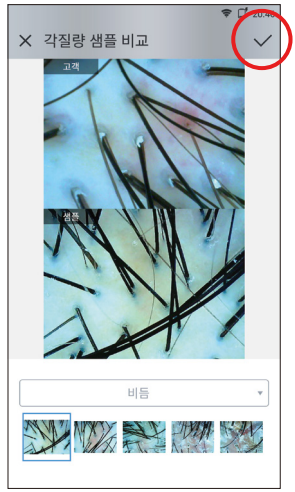

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

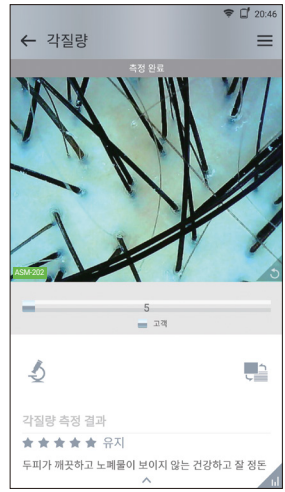

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

혈관 노출 ASM-202

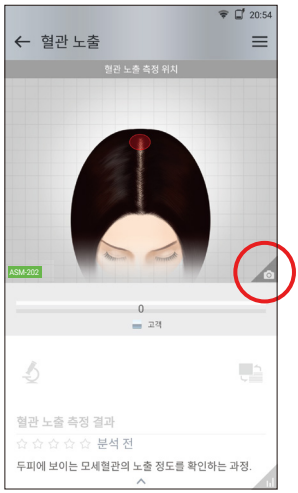

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.



❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

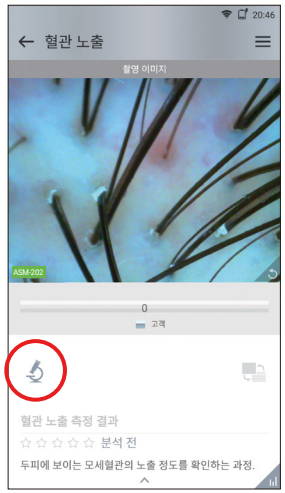

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

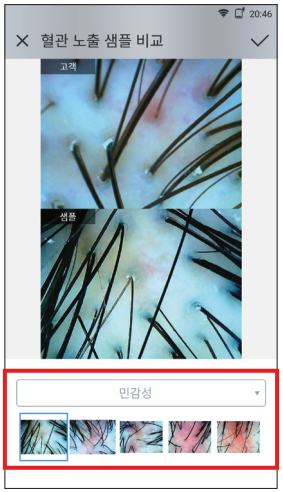

❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

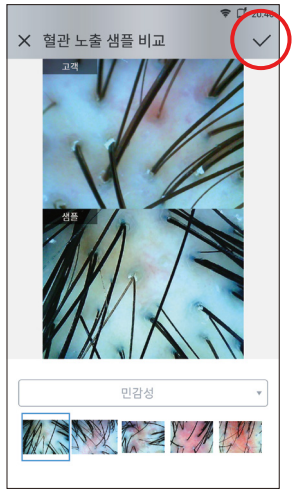

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

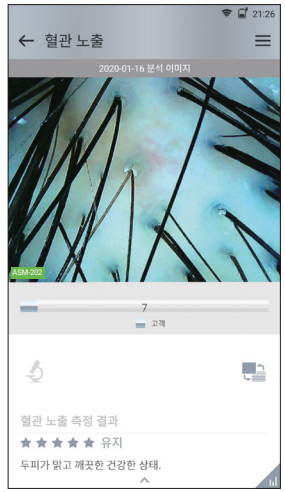

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

렌즈의 탈착 ASM-203

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

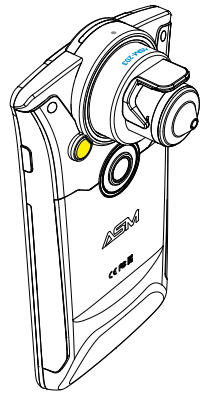

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

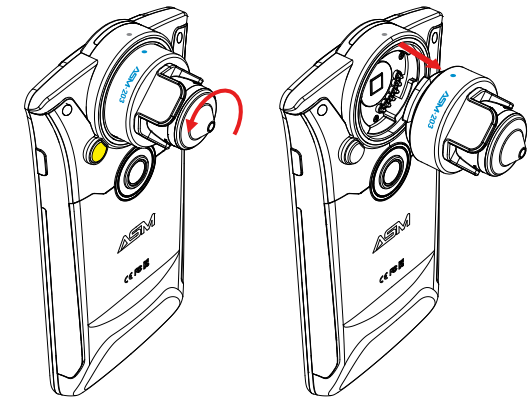

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

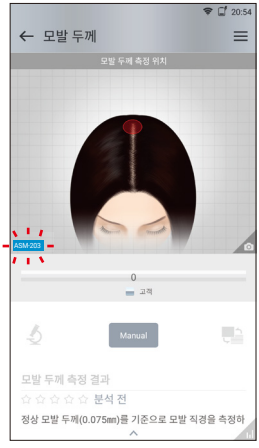

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

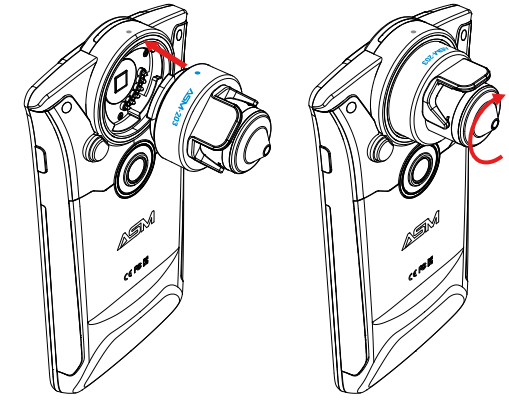

모발 두께 ASM-203

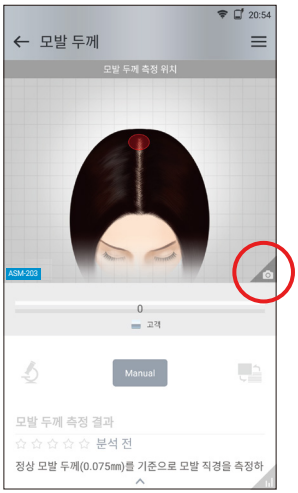

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

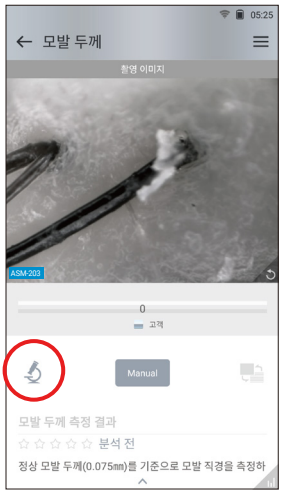

❷ 버튼을 눌러 분석을 시작합니다.



❸ 아래 확대 이미지를 보면서 머리카락의 끝과 끝을 그어주세요.



❹ ❷화면에서 Auto 를 선택할 경우 5번 측정하여 평균값을 계산합니다.

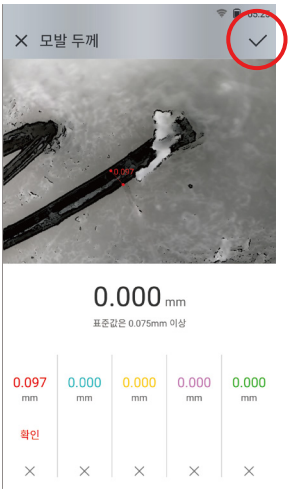

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

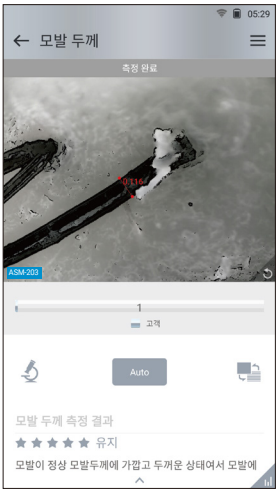

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

모공 상태 ASM-203

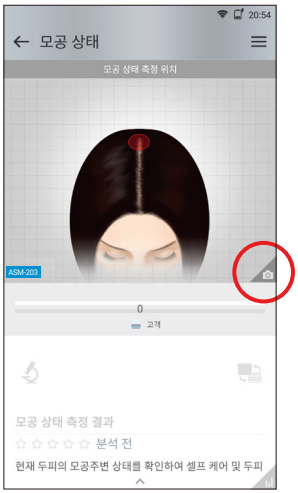

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.



❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

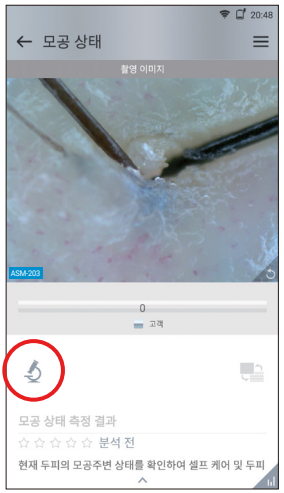

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.



❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.



❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

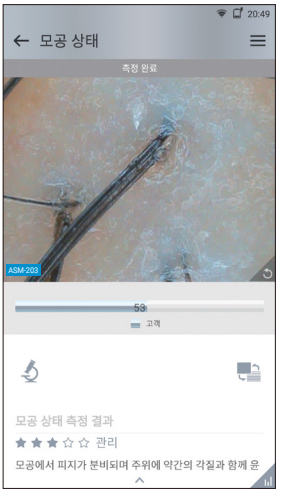

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

렌즈의 탈착 ASM-204

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

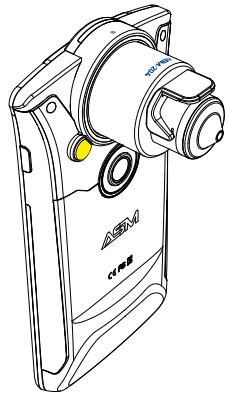

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

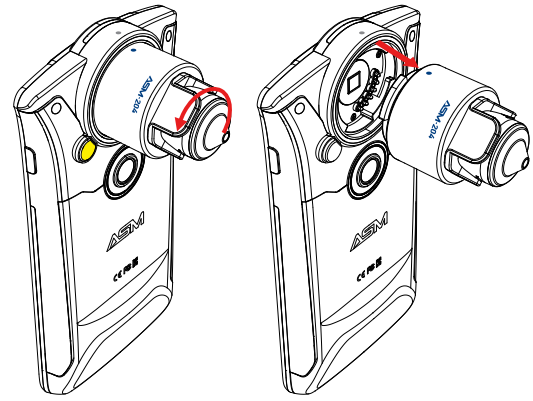

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

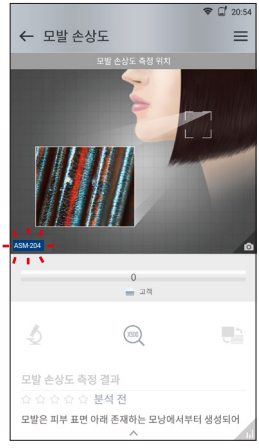

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

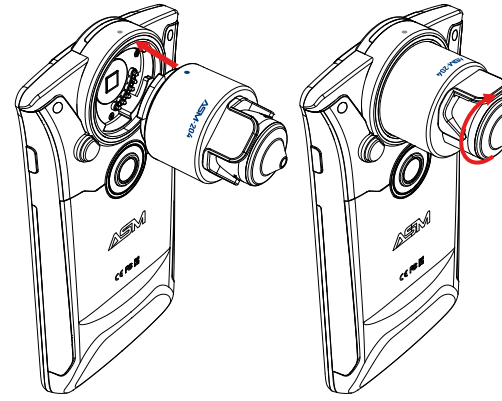

모발 상태 ASM-204

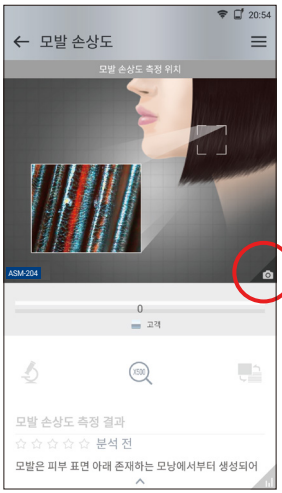

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

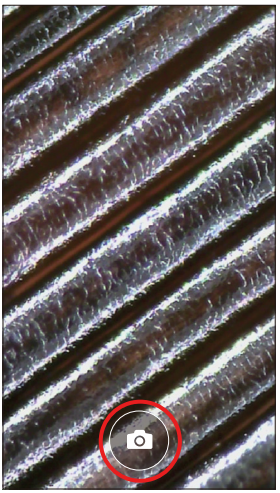

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

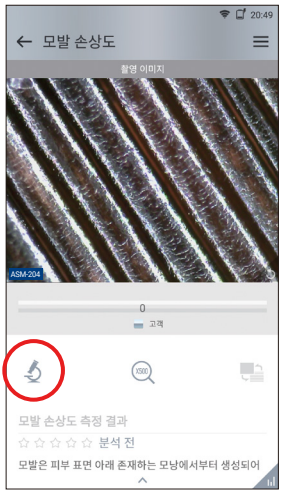

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

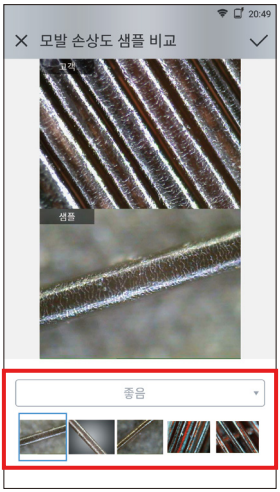

❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

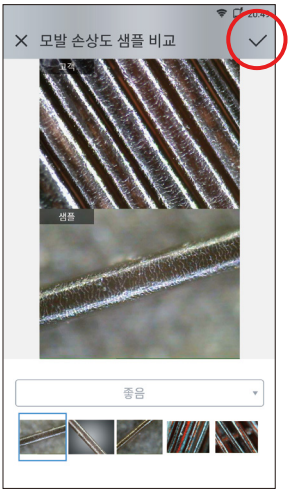

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

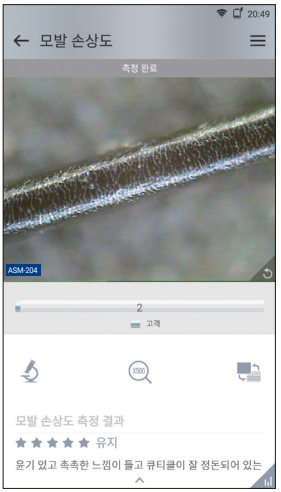

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

종합 결과

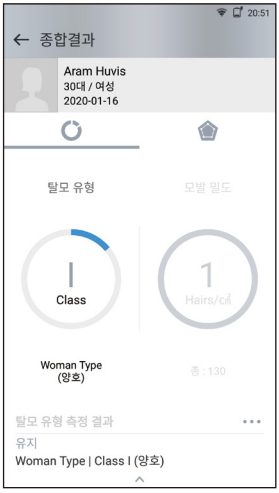

❶ 두 개의 진단 결과 페이지 값을 확인하세요.



❷ 두 번째 장의 각 다른 진단 결과 값을 확인하세요.



❸ 추천제품 보기 및 이메일 보내기를 선택하세요.

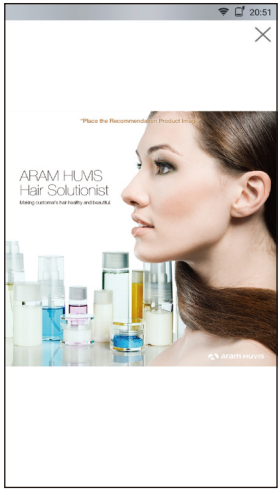

❹ 추천제품 보기를 선택 시, 제품 조회가 가능합니다.

이메일

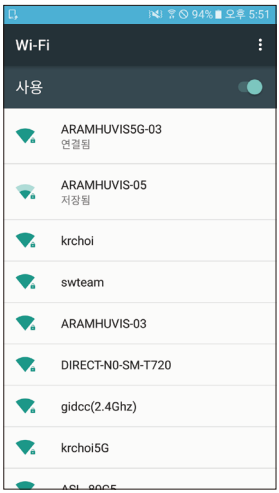

❶ 이메일을 보내기 전에, 장치가 Wi-Fi에 연결되어야합니다.
* 참조 : page 8.



❷ ••• 버튼을 터치하세요.



❸ '이메일 보내기'로 이동하세요.

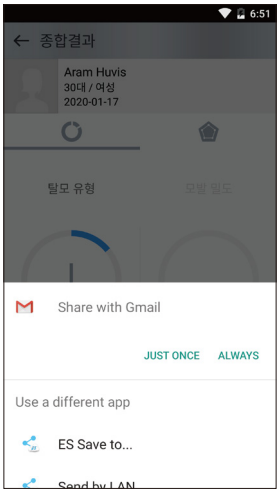

❹ 'Gmail'을 선택하세요

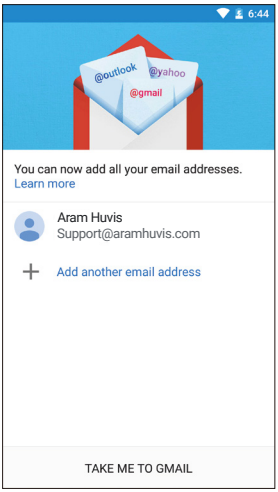

❺ 보낼 메일 계정을 선택하세요.

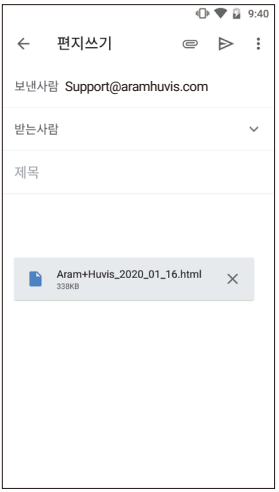

❻ 받는사람 메일주소를 입력하여 진단 결과를 공유합니다.

미러링



❶ ⚙ 버튼을 터치하세요.

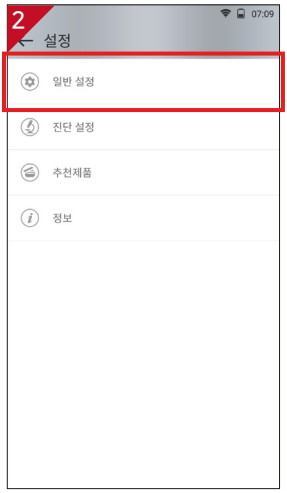

❷ “일반설정”을 터치하세요.



❸ 미러링 옵션을 “켜기”로 설정하세요.
진단기의 SSID가 표시됩니다.



❹ QR 코드를 통해 앱 다운로드
페이지로 이동합니다.

미러링

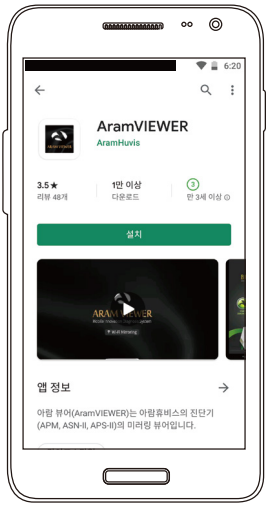

❺ 미러링할 기기에 'Aram VIEWER'를 설치하세요.

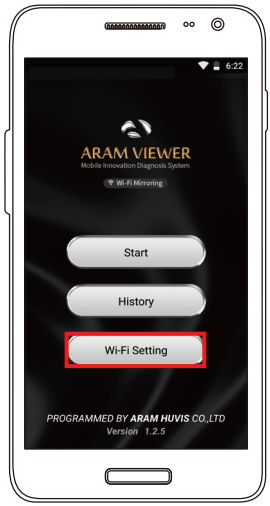

❻ 'Wi-Fi 설정'으로 이동하세요.

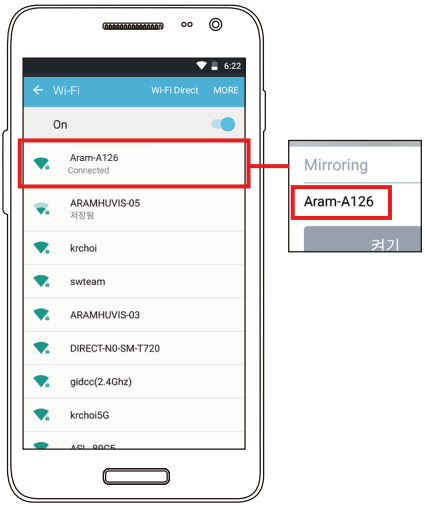

❼ 진단기의 SSID를 선택하세요.



❽ 미러링이 시작됩니다.

화면 보기

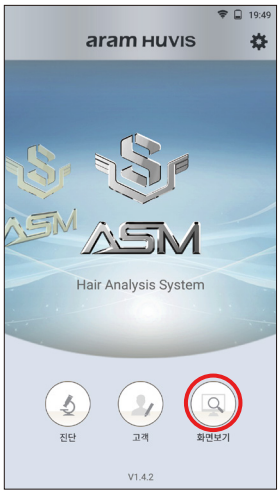

❶ '화면보기' 버튼을 터치하세요.

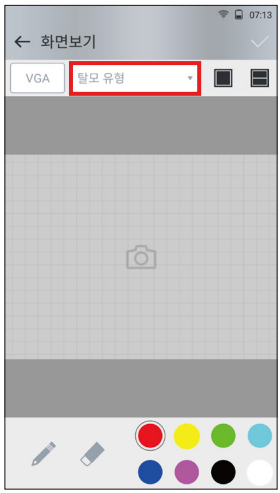

❷ 다양한 모드의 촬영을 할 수 있습니다.

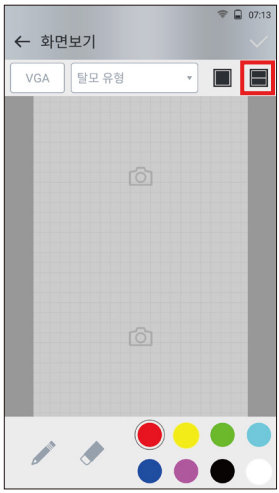

❸ 2장의 사진을 비교할 수 있습니다.

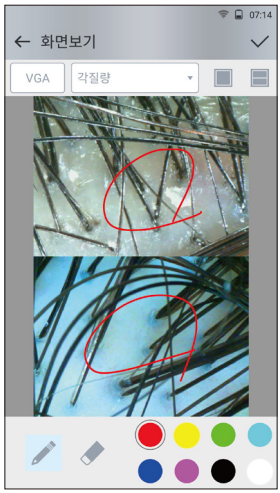

❹ 펜을 이용하여 화면에 표시할 수 있습니다.

보증서

1. 본 제품은 생산 및 출시 전 엄격한 품질 관리 및 검수 과정을 거칩니다.

2. 구매 후 10일 내로 정상적인 조건 하에서 사용 시 기능 및 작동에 결함이 발생한 경우,
   해당 제품을 무료로 수리하거나 신제품으로 교환해 드립니다.

3. 본 제품이 정상적인 조건 하에서 사용된 경우 보증에 따라 무료로 수리해 드립니다.

4. 수리 서비스를 받을 경우를 대비해 보증서를 잘 보관해 주십시오.

5. 보증 기간이 지난 후 수리 비용은 고객 부담입니다

6. 본 제품의 보증 기간은 영수증 발급일로부터 14개월입니다.

7. 비용
   보증 기간 내 : 제품 발송(구매자), 수리 비용 및 제품 회송(아람휴비스)
   - 사용자 실수로 제품이 파손된 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
   - 보증 기간 후 : 제품 발송 및 수리 비용(구매자), 제품 회송(아람휴비스)

8. 보내는 방법 :
   적절한 정보를 얻으려면 support@aramhuvis.com 로 이메일을 보내주세요
   - Tel : 1577-7128

보증서

서비스 신청 양식			
구매일	/ /	회사명	
담당자			
주소 : 전화번호 :			
제품명, 시리얼 번호 : 문제 :			

배송 주소:

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 801호 (우편번호 : 13230)

이메일 : support@aramhuvis.com

전화번호: 1577-7128 / 팩스 : 031-732-6330

메모

메모

aram HUVIS

본사
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 401~402호

생산관리본부
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 벽산테크노피아 909호

Tel: 031-732-6320 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com