ASM 300

사용자 매뉴얼



aram HUVIS

내용

구성요소 3

H/W 부분

각부분의명칭 4
전원 온/오프 5
배터리 및 동작 중 상태 표시 6

시스템 설정

날짜 및 시간 7
Wi-Fi 9

어플리케이션

ⅰ. 설정 10
ⅱ. 고객관리 11
ⅲ. 렌즈의 탈착/장착 피부진단 (ASM-100 렌즈) 12
수분 13
유분 14
모공 15
색소침착 16
피지 17
주름 18
민감도 19
종합결과 20
ⅳ. 렌즈의 탈착/장착 두피진단 (ASM-202 렌즈) 21
탈모유형 22
두피 상태 23
모발밀도 24
각질량 25
혈관노출 26
ⅴ. 렌즈의 탈착/장착 모발진단 (ASM-203 렌즈) 27
모발 두께 28
모공 상태 29
ⅵ. 렌즈의 탈착/장착 모발진단 (ASM-204 렌즈) 30
모발 상태 31
종합결과 32
ⅶ. 이메일 33
ⅷ. 미러링 34
ⅸ. 화면보기 36

보증서 37

구성요소

총 4 렌즈



피부 진단용 렌즈
(ASM 100)



두피 진단용 렌즈
(ASM 202)



모발 진단용 렌즈
(ASM 203)



모발 진단용 렌즈
(ASM 204)

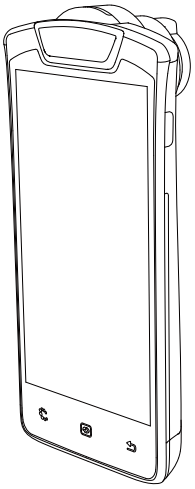

본체와 렌즈
(ASM 100)

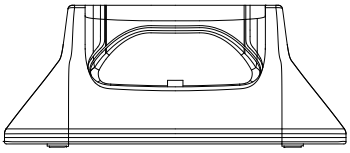

충전 겸용 거치대



유분종이 (2박스)



충전기



USB 케이블



클리닝 패브릭



매뉴얼



에어블로워

각 부분의 명칭

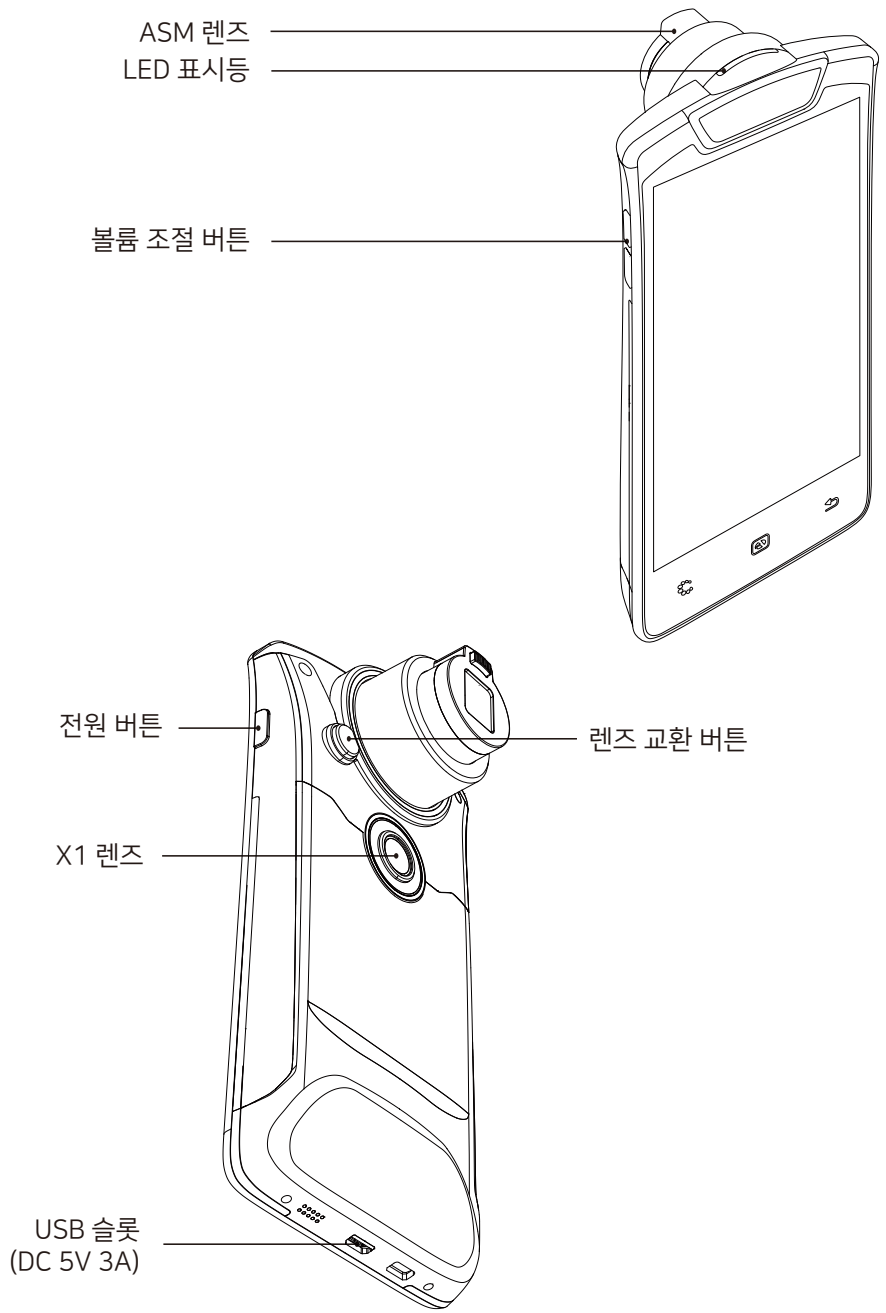

전원 온/오프

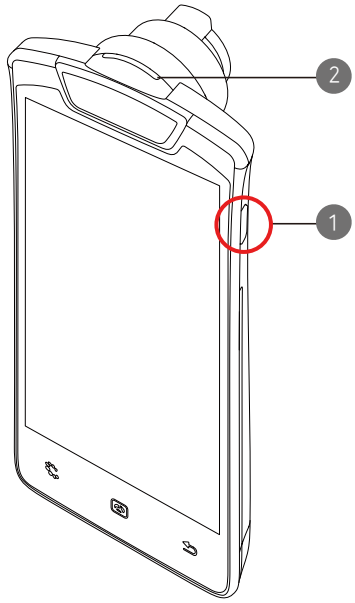

기기 전원 켤 때

1. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
2. 상단의 LED가 켜지면
   전원버튼에서 손을 떼세요.

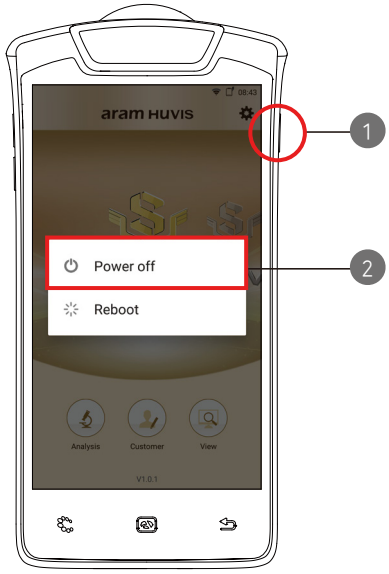

기기 전원 끌 때

1. 전원 버튼을 길게 눌러주세요.
2. 종료를 터치해주세요.

배터리 및 동작 중 상태 표시

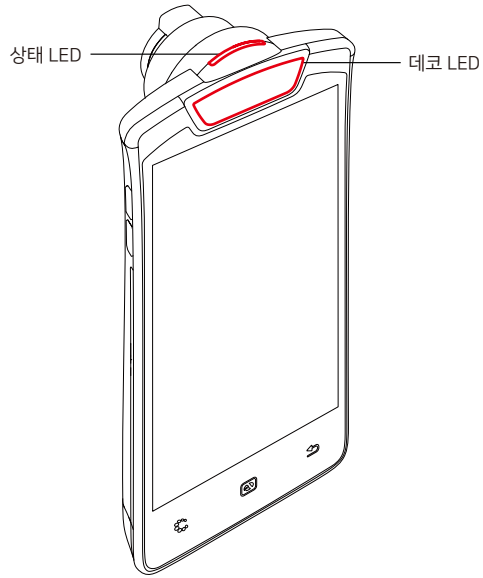

진단기 위치	상태	데코 LED	상태 LED	
사용 중	부팅시	점등	청색 점등	●
사용 중	앱 구동시	점등	꺼짐	●
사용 중	Low 배터리	LCD 화면 상단 인디케이터에서만 표시		
거치대 연결 시	충전 중	꺼짐	적색 점등 (LCD 화면이 꺼졌을 때)	●
거치대 연결 시	충전 완료 (180분)	꺼짐	청색 점등 (LCD 화면이 꺼졌을 때)	●

날짜 및 시간



❶ 버튼을 눌러 홈화면으로 이동합니다.

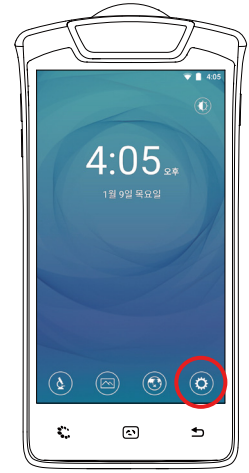

❷ 버튼을 터치하세요.

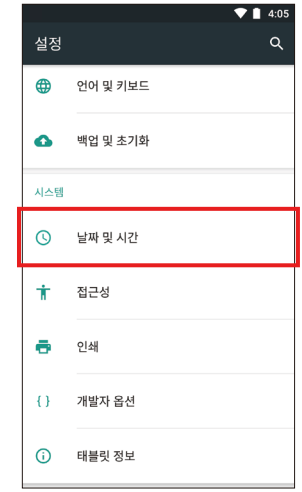

❸ '날짜 및 시간' 메뉴를 터치하세요.

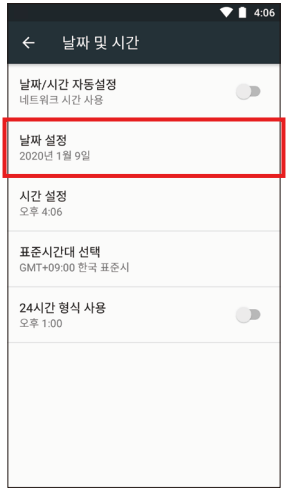

❹ '날짜설정'을 터치하세요.

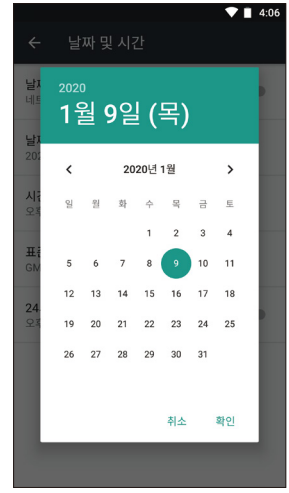

❺ 날짜를 선택하고 확인 버튼을 터치하세요.

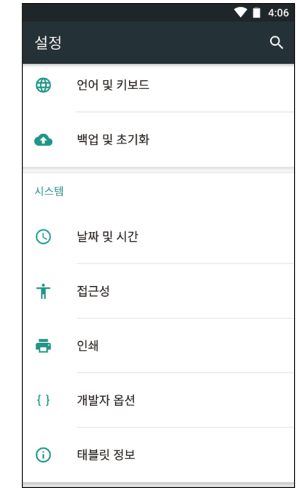

❻ 설정이 올바르게 적용되었는지 확인하세요.

날짜 및 시간

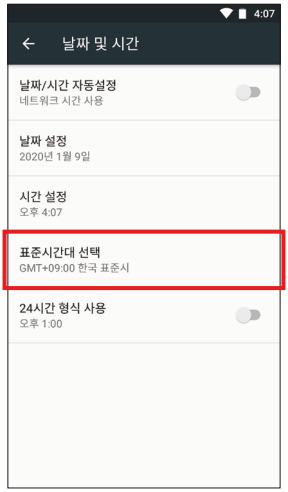

❼ '표준시간대 선택'을 터치하세요.



❽ 해당 국가의 표준시간대를 선택하세요.



❾ 설정이 올바르게 적용되었는지 확인하세요.



❿ '시간설정'을 터치하세요.



⓫ 현재시간으로 변경하고 확인 버튼을 누릅니다.



⓬ 설정이 올바르게 적용되었는지 확인하세요.

Wi-Fi

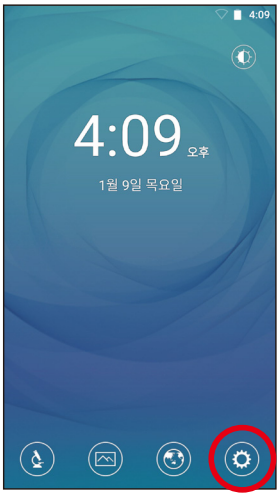

❶ ⚙ 버튼을 터치하세요.

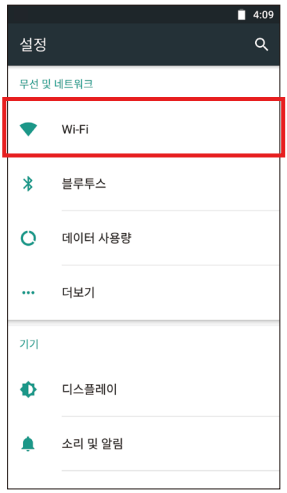

❷ 'Wi-Fi' 메뉴를 터치하세요.



❸ 켜기/끄기 버튼을 사용하여 Wi-Fi를 켜세요.

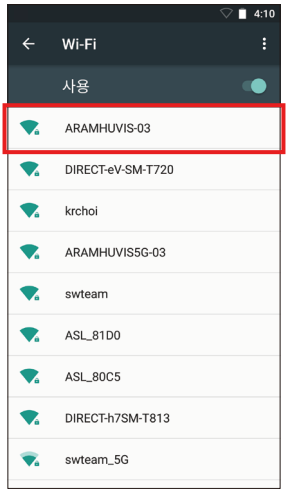

❹ 연결할 Wi-Fi를 선택하세요.

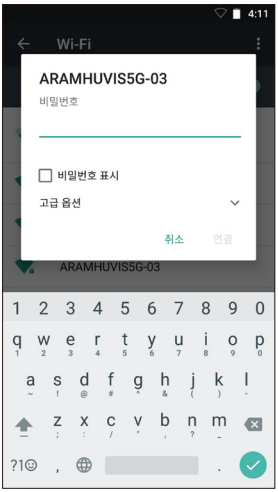

❺ Wi-Fi 비밀번호를 입력하세요.

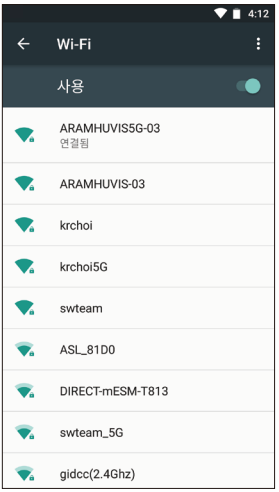

❻ Wi-Fi 연결이 될 때까지 기다리세요.

설정



❶ ⚙ 버튼을 터치하세요.

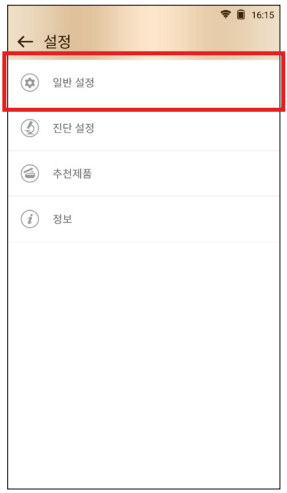

❷ '일반설정'메뉴를 터치하세요.

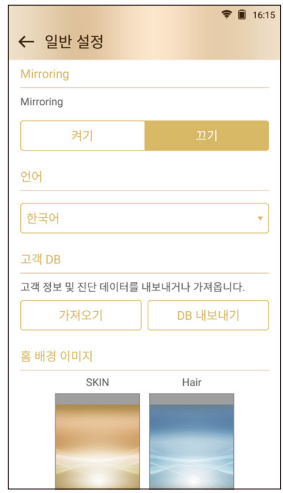

❸ 미러링 및 언어 설정, 고객 DB 관리를 설정 할 수 있습니다.



❹ 진단설정에서는 피부타입과 진단 항목을 선택합니다.

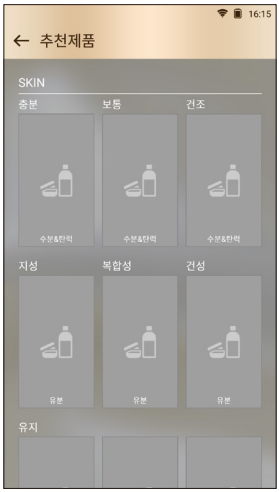

❺ 추천제품에서는 진단 결과에 해당하는 추천제품을 등록합니다.

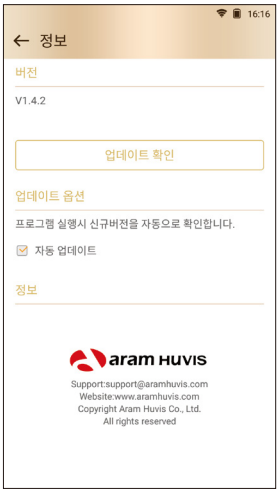

❻ 정보에서 최신 업데이트를 확인하십시오.

고객관리



❶ '고객'메뉴를 터치하세요.

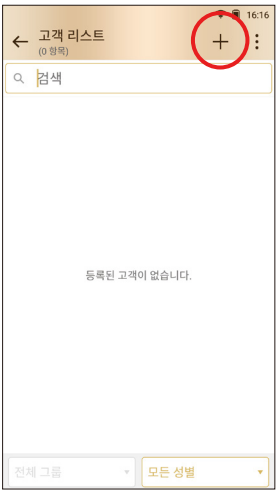

❷ 새 고객을 등록하려면 오른쪽 상단의 '+' 메뉴를 터치하세요

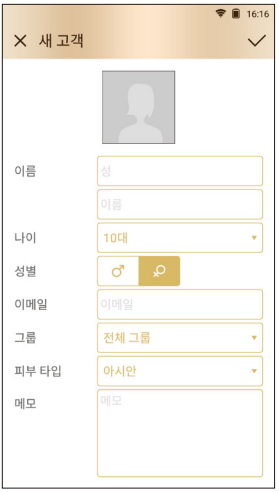

❸ 고객정보를 입력하세요.

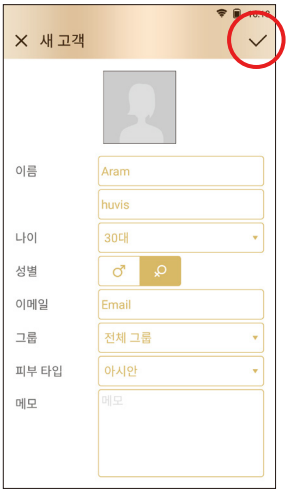

❹ 고객정보를 입력한 후 오른쪽 상단의 ✓버튼을 터치하세요 .

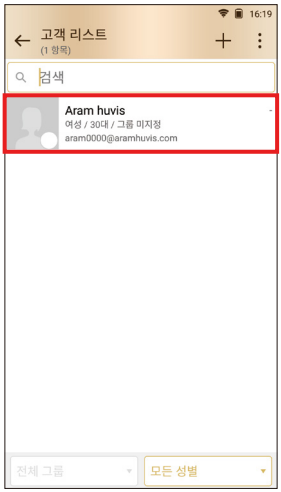

❺ 생성된 사용자 프로필을 선택합니다.

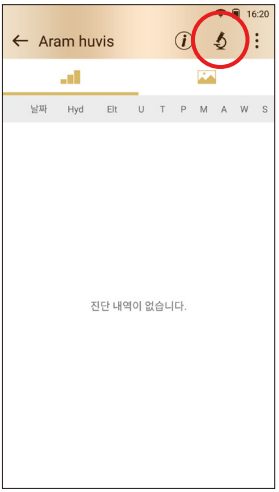

❻진단을 시작하려면 버튼을 터치하세요.

렌즈의 탈착 ASM-100

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

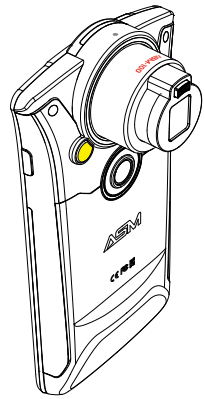

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

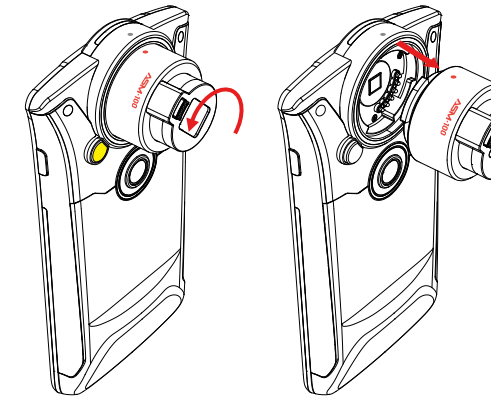

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

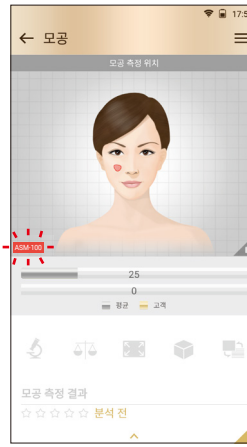

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

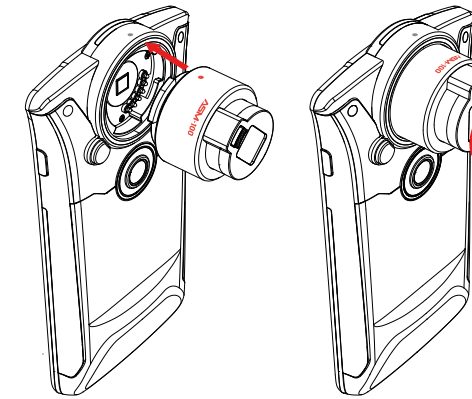

수분 ASM-100

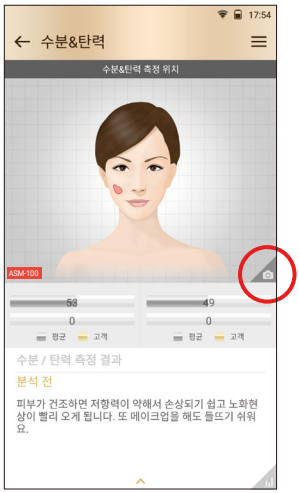

❶ 버튼을 터치하세요.
진동이나 소리가 날때까지 기다리세요.

* “피부에 접촉하세요”라는 문구가 나타나기 전에 센서를 피부 위에 접촉하지 마십시오.

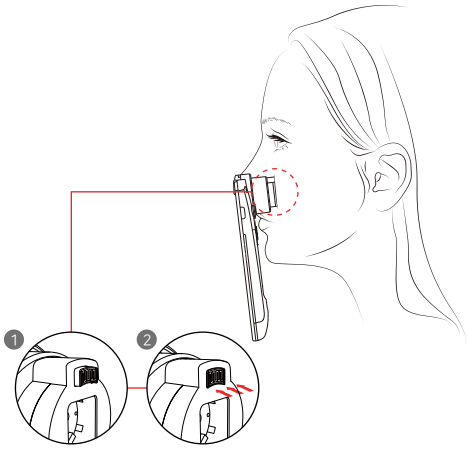

❷ 수분센서를 피부에 완전히 밀착시키세요.

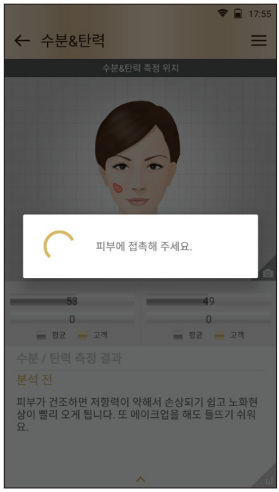

❸ 수분 및 탄력을 측정 중...



❹ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

유분 ASM-100

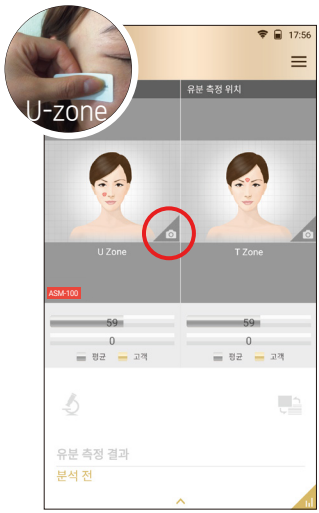

❶ 유분 종이의 분홍색 부분으로 볼(U존)을 2~3초간 누르세요.

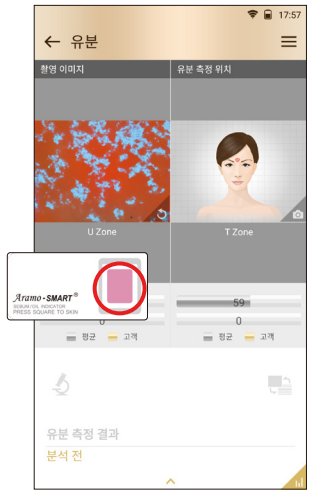

❷ 유분 종이의 분홍색 부분을 촬영하세요.

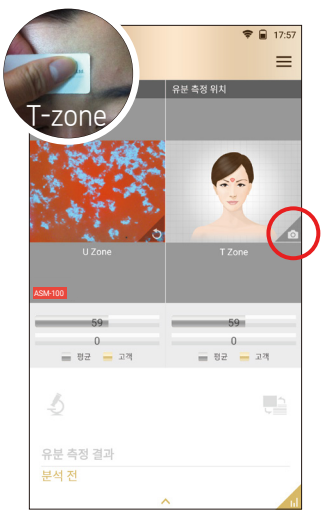

❸ 유분 종이의 분홍색 부분으로 볼(T존)을 2~3초간 누르세요.

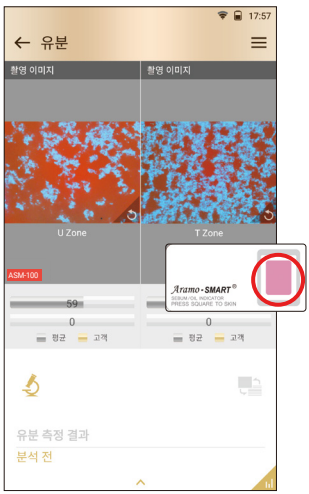

❹ 유분 종이의 분홍색 부분을 촬영합니다.

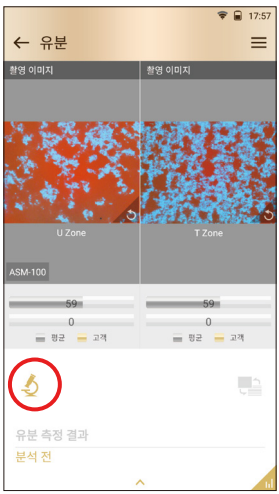

❺ 버튼을 눌러 분석합니다.

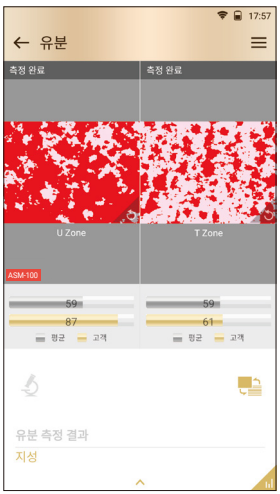

❻ 유분 결과가 나타납니다.

모공 ASM-100



❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

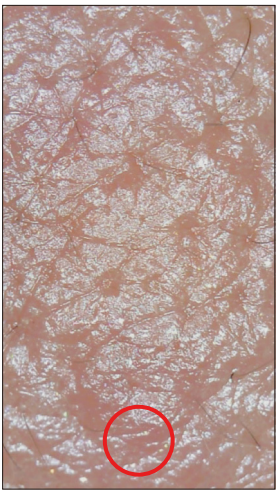

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.



❸ 버튼을 눌러 분석합니다.

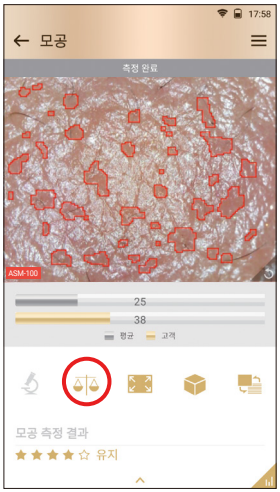

❹ 결과가 나타납니다. 샘플과 비교하려면 버튼을 누르세요.



❺ 촬영된 사진과3가지 샘플이미지를 비교합니다. (좋음/보통/나쁨)



❻ 촬영한 모공 사진을 3D로 변환하려면 버튼을 누르세요.

색소침착 ASM-100



❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

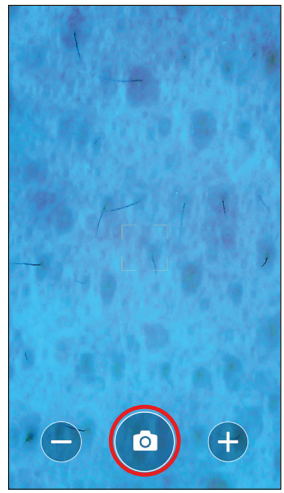

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

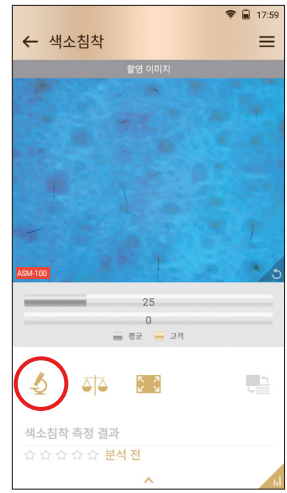

❸ 버튼을 눌러 분석합니다.

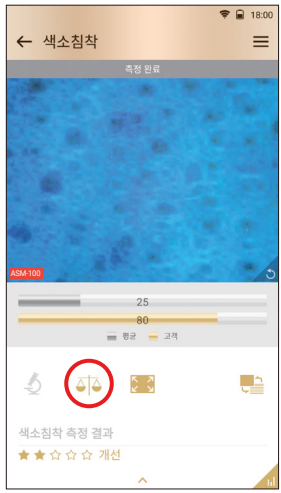

❹ 결과가 나타납니다. 샘플과 비교하려면 버튼을 누르세요.

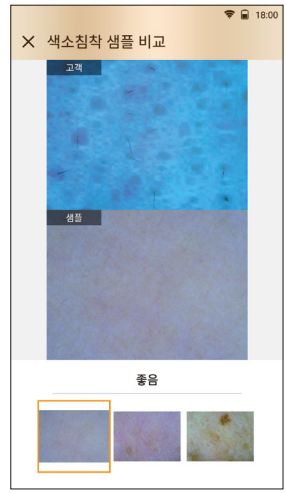

❺ 촬영된 사진과 3가지 샘플이미지를 비교합니다. (좋음/보통/나쁨)

피지 ASM-100



❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

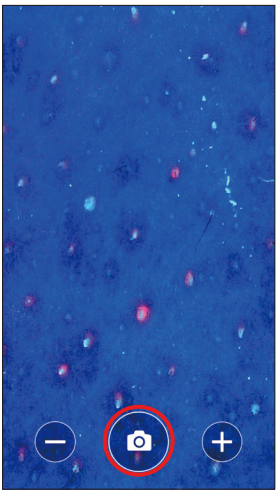

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

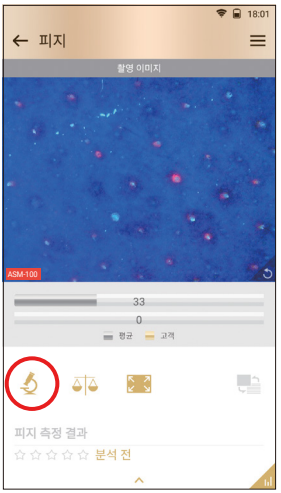

❸ 버튼을 눌러 분석합니다.

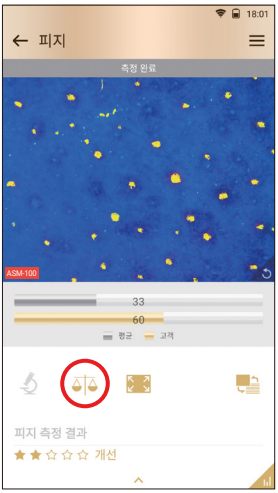

❹ 결과가 나타납니다. 샘플과 비교하려면 버튼을 누르세요.



❺ 촬영된 사진과 3가지 샘플이미지를 비교합니다. (좋음/보통/나쁨)

주름 ASM-100



❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.



❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

*눈가 바깥쪽 주름 부분을 사진을 찍으세요.

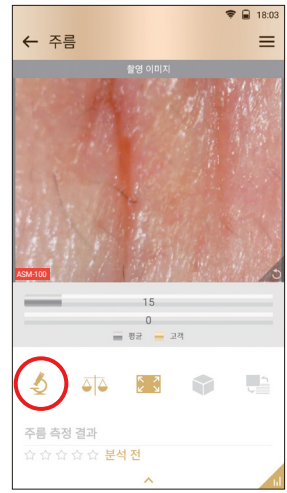

❸ 버튼을 눌러 분석합니다.

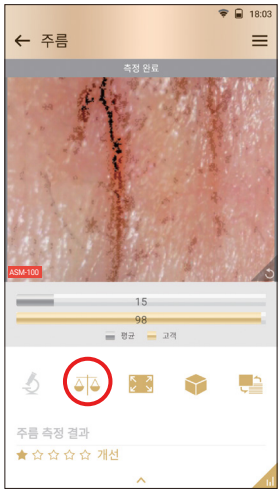

❹ 결과가 나타납니다. 샘플과 비교하려면 버튼을 누르세요.



❺ 촬영된 사진과3가지 샘플이미지를 비교합니다. (좋음/보통/나쁨)



❻ 촬영한 주름 사진을 3D로 변환하려면 버튼을 누르세요.

민감도 ASM-100



❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

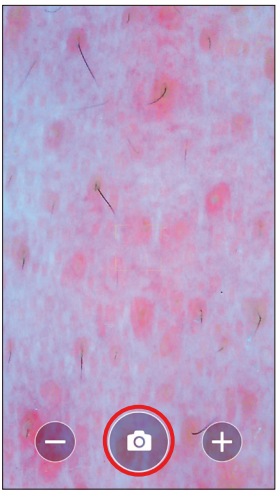

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.



❸ 버튼을 눌러 분석합니다.

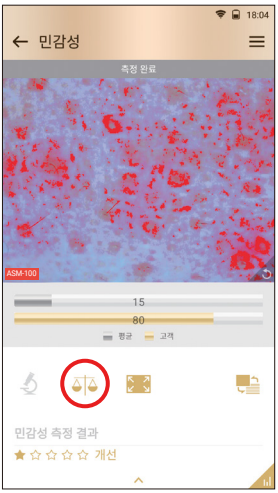

❹ 결과가 나타납니다. 샘플과 비교하려면 버튼을 누르세요.



❺ 촬영된 사진과 3가지 샘플이미지를 비교합니다. (좋음/보통/나쁨)

종합결과





❶ 전체결과를 보려면 버튼 또는 '전체결과보기'를 터치하세요





❷ 진단 결과를 확인할 수 있습니다. 관리가 필요한 항목은 빨간색으로 표시됩니다.

렌즈의 탈착 ASM-202

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

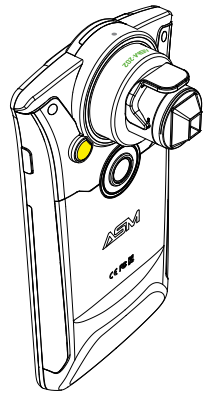

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

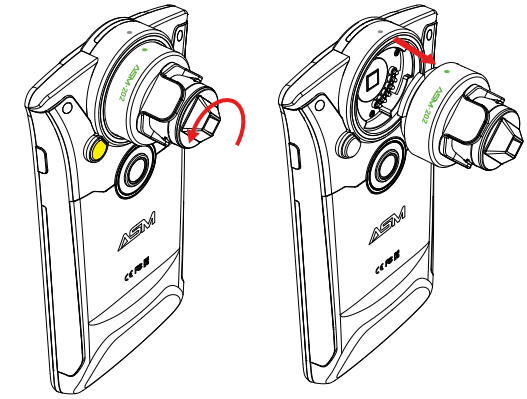

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

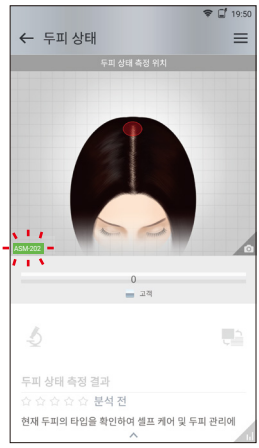

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

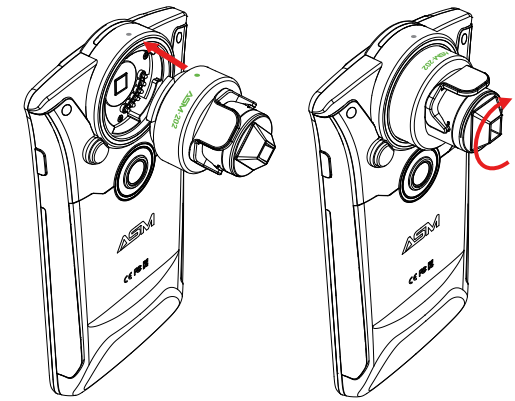

탈모 유형 X1 Lens



❶ '진단'메뉴를 터치하세요.

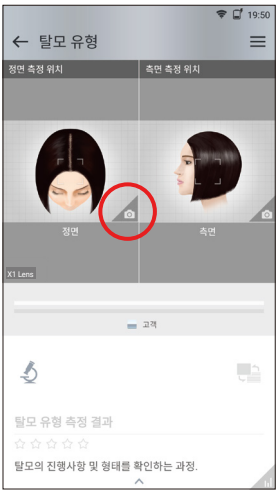

❷ 촬영 위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영 모드로 진입합니다.

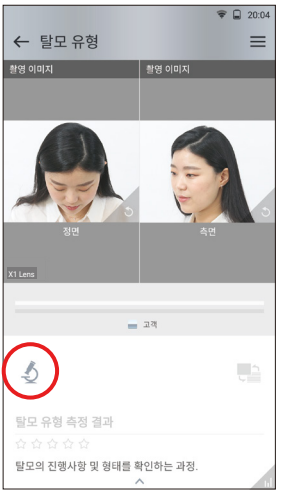

❸ 정면과 측면을 촬영하고 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

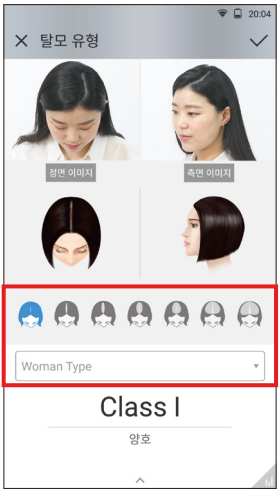

❹ 촬영된 사진에 해당하는 타입과 탈모 진행도를 선택합니다.

*여성의 경우 'Woman Type'만 선택 가능합니다.

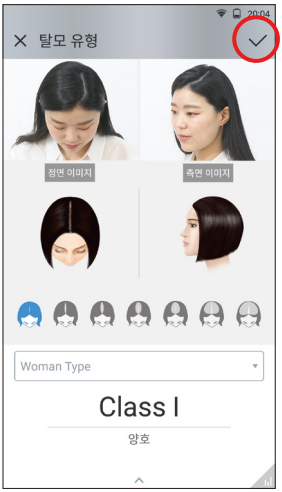

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

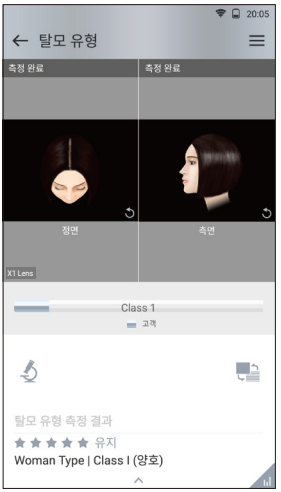

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

두피 상태 ASM-202

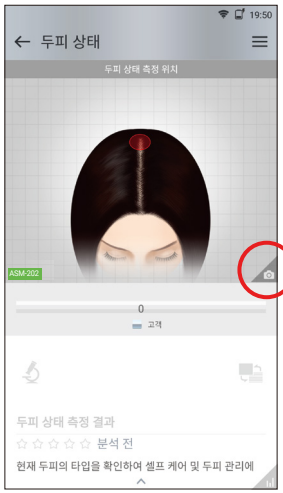

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

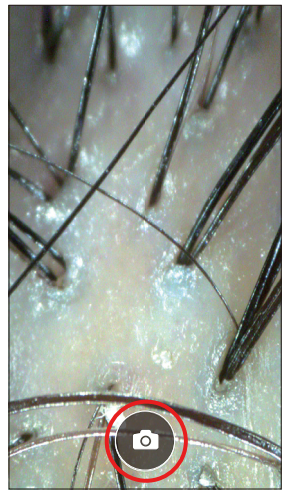

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

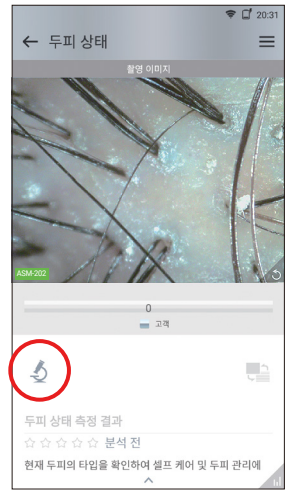

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.



❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

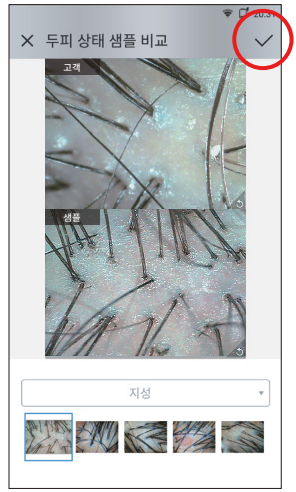

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

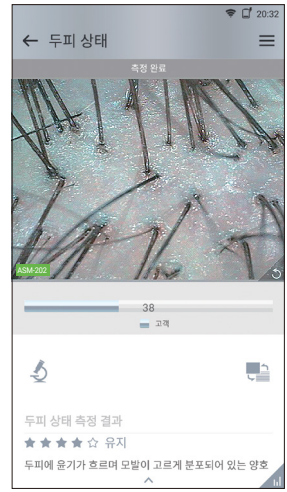

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

모발 밀도 ASM-202

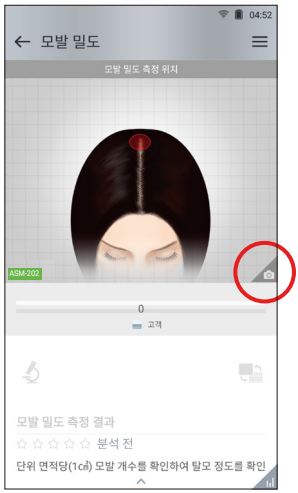

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

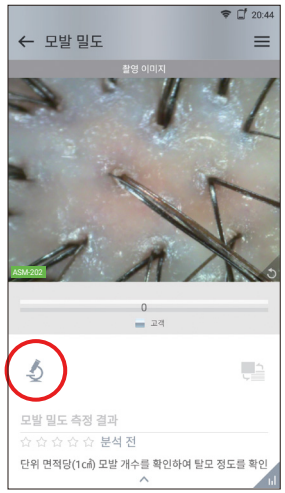

❷ 촬영후 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.



❸ 을 선택하고 사진에서 모발이 1개인 모공을 터치합니다.

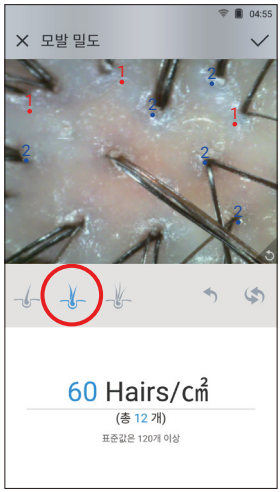

❹ 마찬가지로 모발이 2개, 3개인 모공을 각각 터치하여 합산합니다.

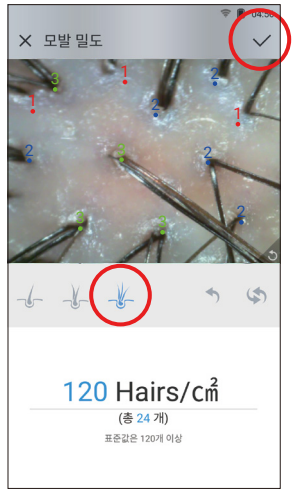

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

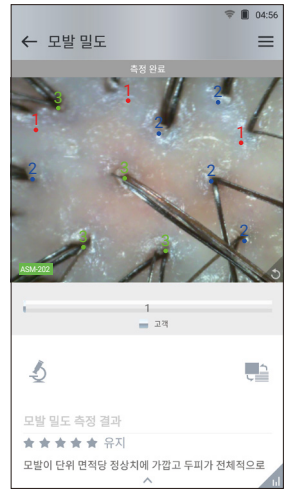

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

각질량 ASM-202

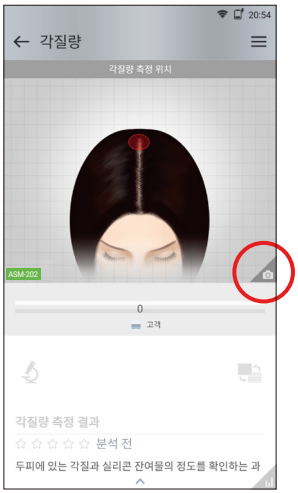

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

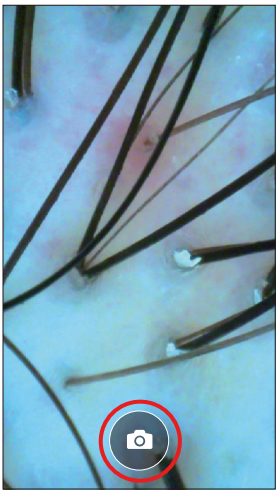

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

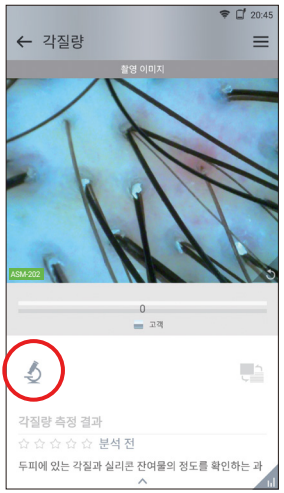

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

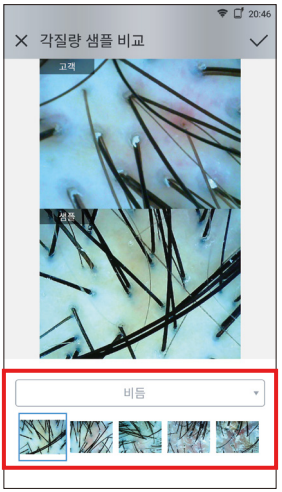

❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

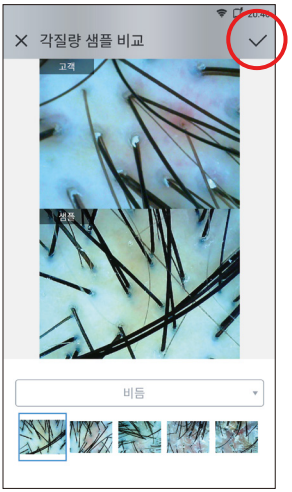

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

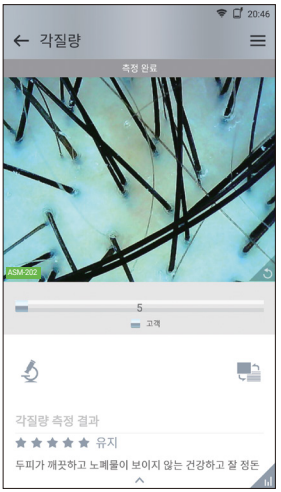

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

혈관 노출 ASM-202

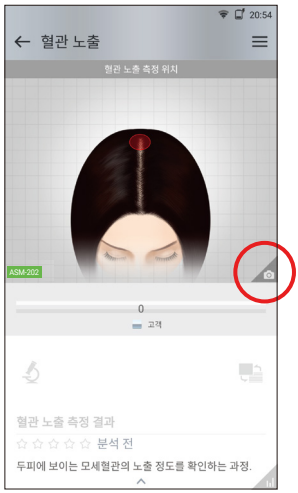

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.



❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

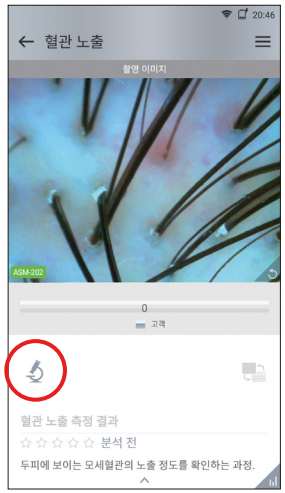

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

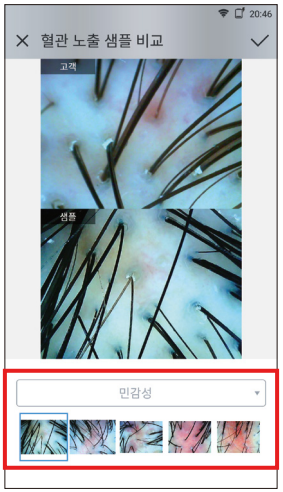

❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

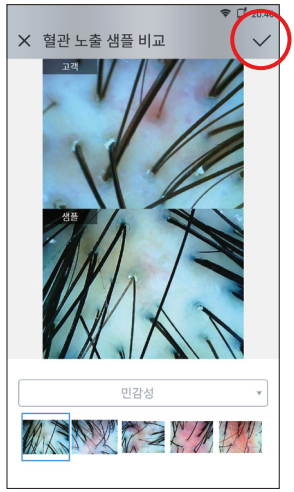

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

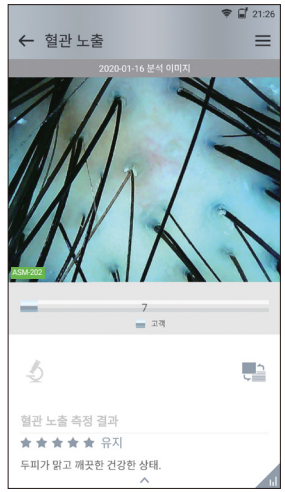

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

렌즈의 탈착 ASM-203

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

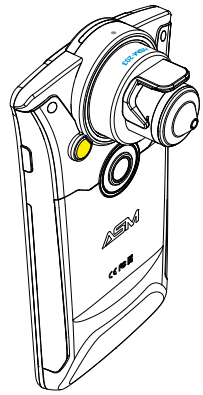

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

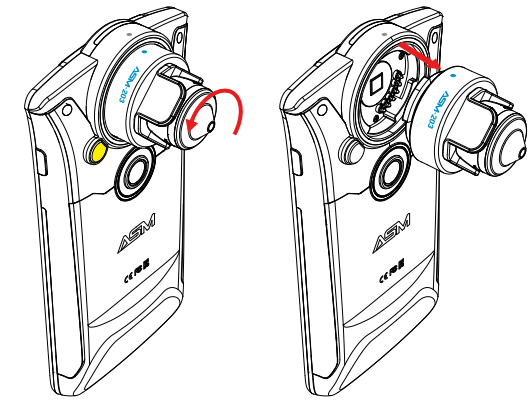

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

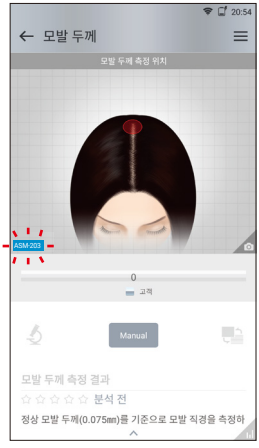

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

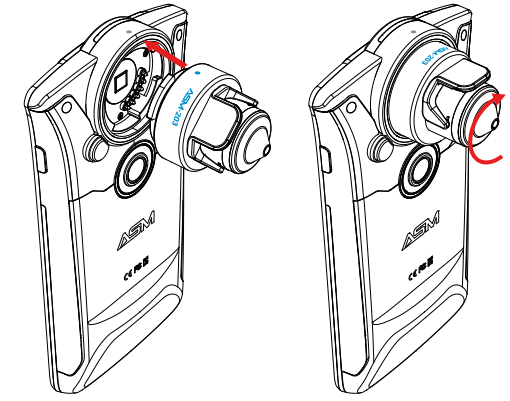

모발 두께 ASM-203

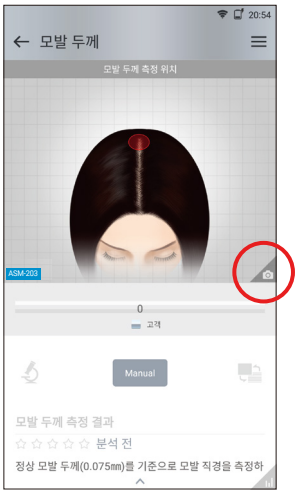

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

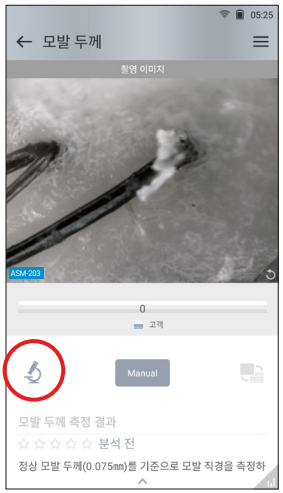

❷ 버튼을 눌러 분석을 시작합니다.



❸ 아래 확대 이미지를 보면서 머리카락의 끝과 끝을 그어주세요.

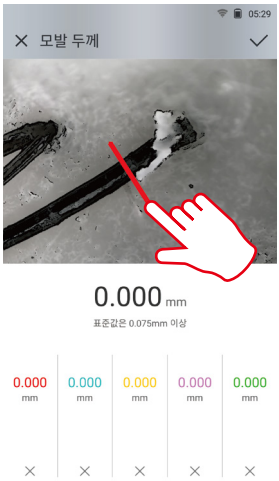

❹ ❷화면에서 Auto 를 선택할 경우 5번 측정하여 평균값을 계산합니다.

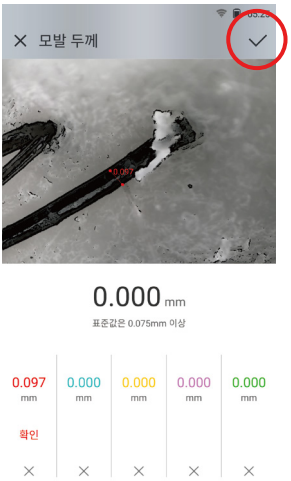

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

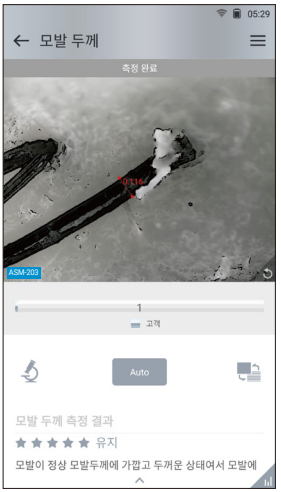

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

모공 상태 ASM-203

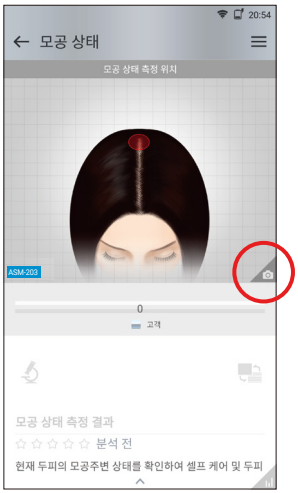

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.



❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

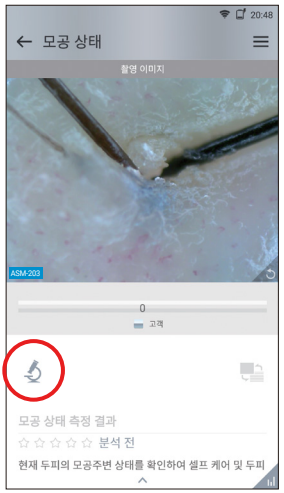

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.



❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.



❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

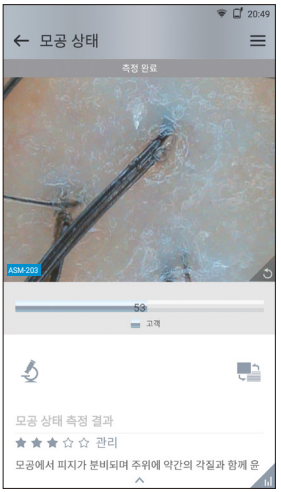

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

렌즈의 탈착 ASM-204

❶ 렌즈를 분리하려면 렌즈 왼쪽 아래의 렌즈 교환 버튼을 누릅니다.

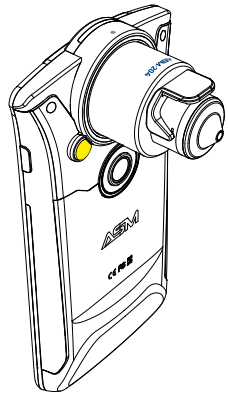

❷ 렌즈 교환 버튼을 누른 채 렌즈를 반시계 방향으로 45도 돌려서 탈착합니다.

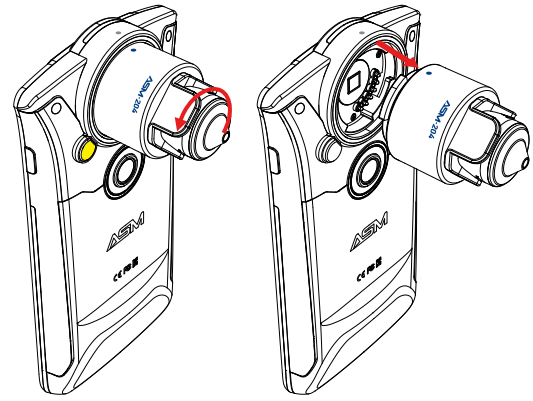

렌즈의 장착

❶ 진단 메뉴에 해당하는 전용 렌즈를 장착하기 전까지 화면의 렌즈 표시 라벨이 깜빡입니다.

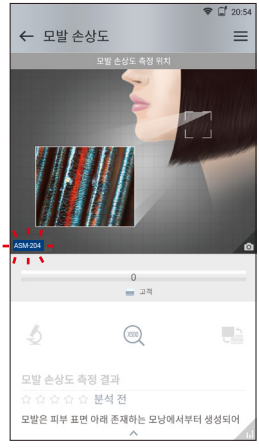

❷ 렌즈를 장착하려면 렌즈의 점(●)과 본체의 점(●)의 위치를 일치하게 넣고 시계 방향으로 돌려 장착시킵니다.

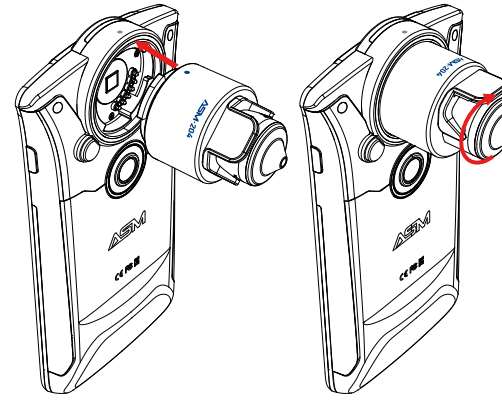

모발 상태 ASM-204

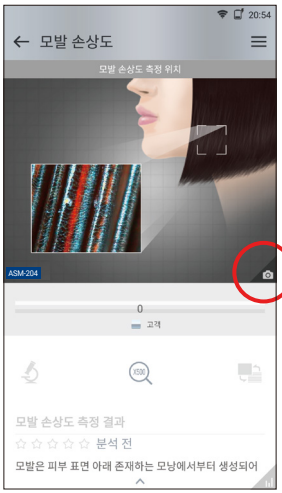

❶ 촬영위치를 확인하고 버튼을 눌러 촬영모드로 진입합니다.

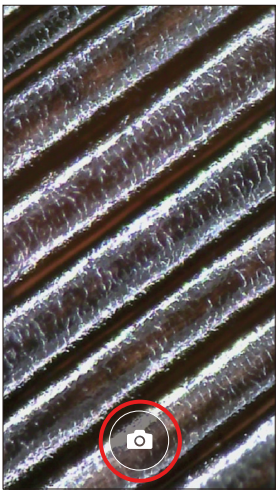

❷ 촬영 부위에 초점을 맞춘 다음 버튼을 눌러 촬영합니다.

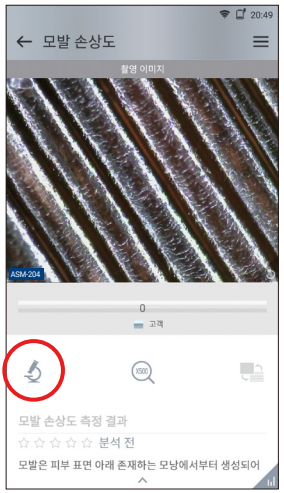

❸ 을 눌러 분석 모드로 이동합니다.

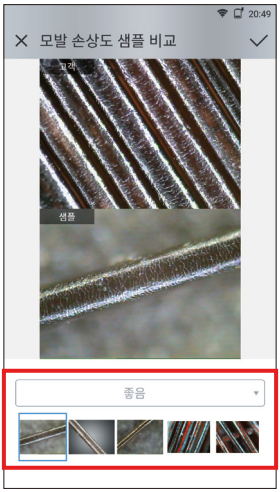

❹ 촬영된 사진과 유사한 타입과 샘플 이미지를 선택하세요.

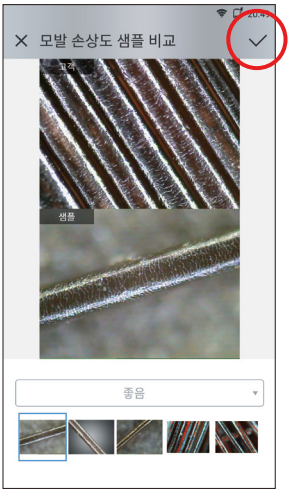

❺ 분석을 마치려면 ✓를 눌러 저장합니다.

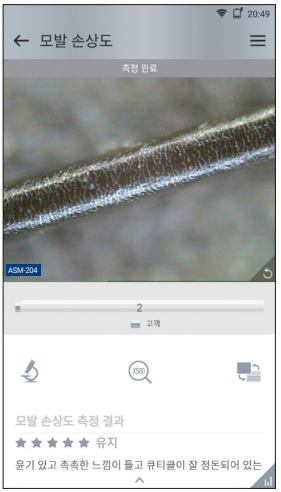

❻ 결과를 확인하세요.
다음 화면으로 이동하려면 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 밀어주세요.

종합 결과

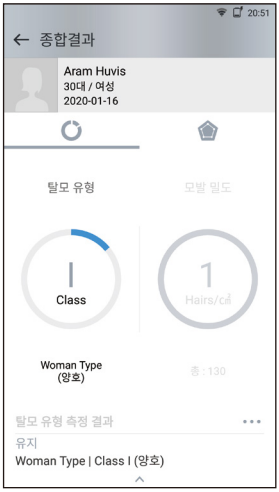

❶ 두 개의 진단 결과 페이지 값을 확인하세요.



❷ 두 번째 장의 각 다른 진단 결과 값을 확인하세요.



❸ 추천제품 보기 및 이메일 보내기를 선택하세요.

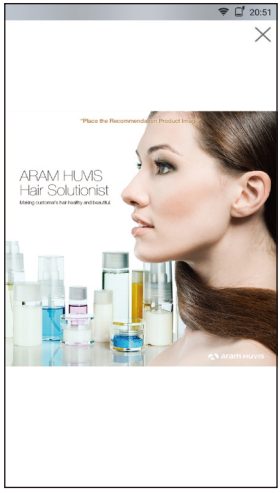

❹ 추천제품 보기를 선택 시, 제품 조회가 가능합니다.

이메일



❶ 이메일을 보내기 전에, 장치가 Wi-Fi에 연결되어야합니다.



❷ ••• 버튼을 터치하세요.



❸ '이메일 보내기'로 이동하세요.

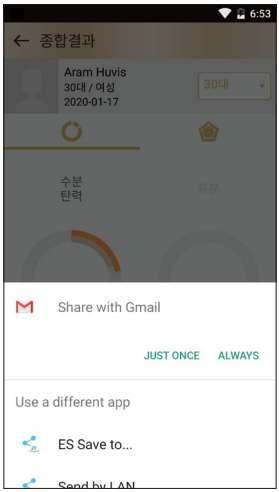

❹ 'Gmail'을 선택하세요

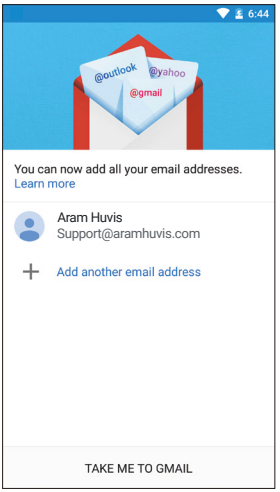

❺ 보낼 메일 계정을 선택하세요.

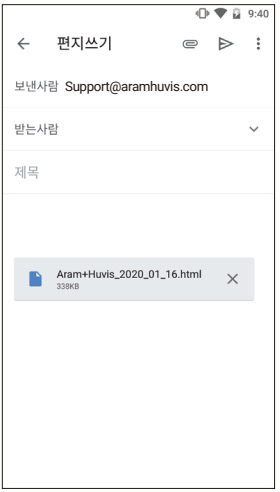

❻ 받는사람 메일주소를 입력하여 진단 결과를 공유합니다.

미러링



❶ ⚙ 버튼을 터치하세요.

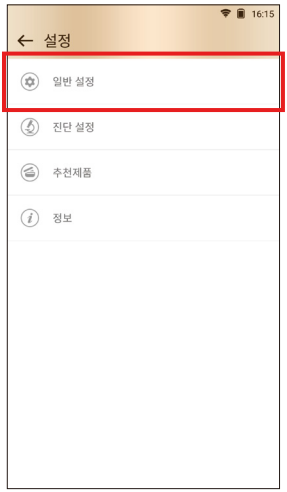

❷ “일반설정”을 터치하세요.



❸ 미러링 옵션을 “켜기”로 설정하세요.



❹ QR 코드를 통해 앱 다운로드 페이지로 이동합니다.

미러링

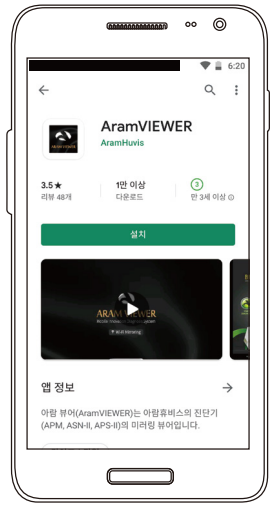

❺ 미러링할 기기에 'Aram VIEWER'를 설치하세요.



❻ 'Wi-Fi 설정'으로 이동하세요.

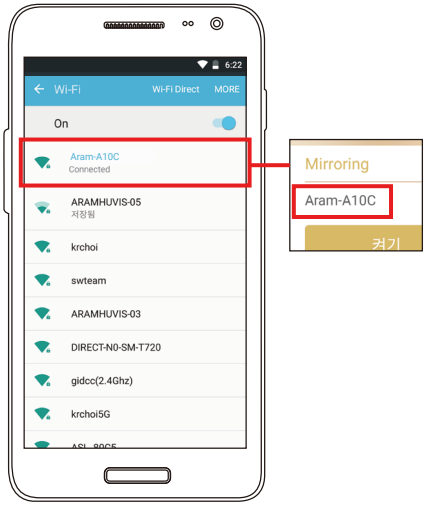

❼ 진단기의 SSID를 선택하세요.



❽ 미러링이 시작됩니다.

화면 보기



❶ '화면보기' 버튼을 터치하세요.



❷ 다양한 모드의 촬영을 할 수 있습니다.



❸ 2장의 사진을 비교할 수 있습니다.



❹ 펜을 이용하여 화면에 표시할 수 있습니다.

보증서

1. 본 제품은 생산 및 출시 전 엄격한 품질 관리 및 검수 과정을 거칩니다.

2. 구매 후 10일 내로 정상적인 조건 하에서 사용 시 기능 및 작동에 결함이 발생한 경우,
   해당 제품을 무료로 수리하거나 신제품으로 교환해 드립니다.

3. 본 제품이 정상적인 조건 하에서 사용된 경우 보증에 따라 무료로 수리해 드립니다.

4. 수리 서비스를 받을 경우를 대비해 보증서를 잘 보관해 주십시오.

5. 보증 기간이 지난 후 수리 비용은 고객 부담입니다.

6. 본 제품의 보증 기간은 영수증 발급일로부터 14개월입니다.

7. 비용
   보증 기간 내 : 제품 발송(구매자), 수리 비용 및 제품 회송(아람휴비스)
   - 사용자 실수로 제품이 파손된 경우 수리 비용이 청구될 수 있습니다.
   - 보증 기간 후 : 제품 발송 및 수리 비용(구매자), 제품 회송(아람휴비스)

8. 보내는 방법 :
   적절한 정보를 얻으려면 support@aramhuvis.com 로 이메일을 보내주세요
   - Tel : 1577-7128

보증서

서비스 신청 양식			
구매일	/ /	회사명	
담당자			
주소 : 전화번호 :			
제품명, 시리얼 번호 : 문제 :			

배송 주소:

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 801호 (우편번호 : 13230)

이메일 : support@aramhuvis.com

전화번호: 1577-7128 / 팩스 : 031-732-6330

메모

aram HUVIS

본사
경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크 401~402호

생산관리본부
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 벽산테크노피아 909호

Tel: 031-732-6320 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com